

สำนักงาน  
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโซตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวิทิต ชูศรียิ่ง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๙๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๐/๑๕ หมู่ ๑๐ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาว อัณชัยารักษ์ มีเรือนทิพย์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๘๒๒๐๘๒๖๐๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๕๕๓๕๓๐๐๕๘๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่มีสัมผัสระยะห่าง ยี่ห้อ Shin Nippon รุ่น NCT-๒๐๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๗๕๐.๐๐ บาท (สีแคนส์หมีนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อ BAM รุ่น BAM-๒๐๐A จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)

เป็นราคายังสิ้น ๔๖๒,๙๕๕.๐๐ บาท (สีแคนส์หมีนสองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๐,๒๖๖.๗๗ บาท (สามหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย



(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นางสาวอัณชัยารักษ์ มีเรือนทิพย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสิริชัย พันแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

### ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผู้นำก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๓.๒ ผู้นำก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๓.๓ ผู้นำก ๓ แคตตาล็อก	จำนวน ๑๕ (สิบห้า)	หน้า
๓.๔ ผู้นำก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๓.๕ ผู้นำก ๕ เอกสารบริษัทฯ	จำนวน ๑๕ (สิบห้า)	หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

### ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลจอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทบหัวหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย โดยผู้เสนอราคาจะต้องฝึกสอนการใช้และการซ่อมบำรุง ให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบท้ายที่ต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลจอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของ ผู้ซื้อ

### ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่นว่า ผู้ขายต้องรับนำเสนอสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำเสนอสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือลดค่าปรับไม่ได้

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... พยาน


(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นางสาวอัมราวดี คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

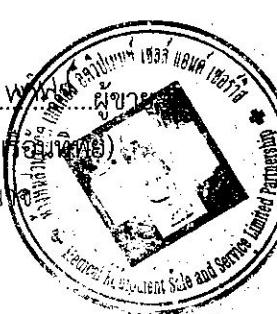

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสิริวัณี ปันแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาี้น ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อร้านค้ากรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ ชื่อบัญชี หจก.เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่บัญชี ๕๒๑-๑-๔๔๒๖๙-๓ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

## ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อよดูในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ขอค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อนาจรออยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

## ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่นเองผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๓๗๖๗๓๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๑๔๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... พยาน


(นายเกียรติศักดิ์ ตัน奴)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับมอบ

(นางสาวอันชนียารัตน์ เพ็ญทิพย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

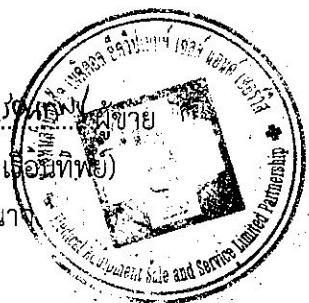

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสิริชัย ปันแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขาย พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวง ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบ สิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เปเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิก สัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ) .....  
ผู้ซื้อ  
(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดร  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)  
นักจัดการงานที่ว่าไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ร.ต.ต.๗๗๗๗๗๗  
(นางสาวอัณชัยารักษ์ ใจเด่นพิทย์)  
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสิริชวัญ ปันแก้ว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



### ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิ์ของเอกสารเดิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงชื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากการคำสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิ์ของเอกสารเดิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์ของเอกสารเดิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ แล) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อด้วยจังหวะเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิ์จะปรับผู้ขายจนถึงวันของเอกสารเดิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิงกายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อหากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขาย ที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด


### ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิ์ของดังนี้ ให้ผู้ซื้อชำระค่าปรับหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว


(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นางสาวอัณชยารัตน์ นุวอนพิทย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางศิริชัย ปันแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับมอบ

(นางสาวอัณชยารัศมี ไกรฤทธิ์พย)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสิริชวัญ ปันแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารประกอบสัญญา  
ซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

๑. ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๒. ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๓. ผนวก ๓ แคตตาล็อก	จำนวน ๑๕ (สิบห้า)	หน้า
๔. ผนวก ๔ ในเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๕. ผนวก ๕ เอกสารบริษัทฯ	จำนวน ๑๕ (สิบห้า)	หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง<sup>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่</sup>  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย บริษัทฯ

(นางสาวอัมชนารัตน์ เรือนทิพย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย พยาน

(นางสิริขวัญ ปันแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกแผ่นคือ

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายวิทิต ชูศรียิ่ง           | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง <sup>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่</sup> |
| ๒. นายเกียรติศักดิ์ ตันภู       | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   |
| ๓. นางสิริขวัญ ปันแก้ว          | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  |
| ๔. นางสาวอัมชนารัตน์ เรือนทิพย์ | ตำแหน่ง ผู้ขาย (ผู้รับมอบอำนาจ)  |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องวัดความดันสูกตาแบบไม่สัมผัสกระจากตา

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องวัดความดันสูกตาระบบอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัสนิดใช้ลมเป่า
๒. รายละเอียดที่นำไป
  - ๒.๑ เป็นเครื่องวัดความดันสูกตาระบบอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัส ชนิดใช้ลมเป่า
  - ๒.๒ มีเครื่องพิมพ์ในตัว
  - ๒.๓ ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮริทซ์
๓. รายละเอียดทางเทคนิค
  - ๓.๑ มีระบบการวัด ๓ แบบ คือ (๑) ระบบ Auto (๒) ระบบ Auto แบบสามารถกำหนดจำนวนครั้ง (๓) ระบบ Manual
  - ๓.๒ มีช่วงการวัด ๑- ๖๐ mmHg, มีความละเอียดในการวัดขั้นละ ๑ mmHg หรือ ๐.๑ ถึง ๘.๐ kPa มีความละเอียดในการวัด ขั้นละ ๐.๑ kPa
  - ๓.๓ ระยะในการทำงานของเครื่อง (Working Distance) ประมาณ ๑๑ มิลลิเมตร
  - ๓.๔ มีไฟเปามองให้คนไข้มองจากภายใน (Internal Target) ของช่องลมเป่า โดยสามารถตั้งไฟเปามองให้เป็นแบบติดค้าง หรือ แบบกระพริบ ได้
  - ๓.๕ มีที่วางคางของคนไข้ สามารถปรับขึ้นลงได้
  - ๓.๖ มี Joy Stick เพียงอันเดียว สามารถปรับโดยกดตัวเครื่อง ให้เดินหน้า- ถอยหลัง, เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย-ขวา, และเลื่อนขึ้นบน-ล่าง ได้
  - ๓.๗ มีจอแสดงภาพแบบจอ LCD size ขนาด ๕.๗ นิ้ว, สามารถปรับระดับความสูงต่ำของจอภาพให้ก้ม-งอได้ ๙๐ องศา, ซ้าย-ขวาได้ ๓๐ องศา เพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้วัด, สามารถแสดงการปรับระยะไฟกั๊ส, ผลการวัด, ค่าสรุป และข้อมูลต่าง ๆ, และจอภาพสามารถดับได้เมื่อไม่ใช้เครื่อง (Power Saving Function) ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งได้ ๓, ๕, ๑๐ นาที หรือไม่ให้จอภาพดับเลยก็ได้
  - ๓.๘ เมื่อผู้ใช้ทำการปรับเครื่อง ให้เครื่องหมายสีเหลี่ยมของเครื่องตรงกับตาตำแหน่งคนไข้ และทำการโยก Joy Stick เดินหน้า จนกระทั่งเครื่องหมายสีเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นสีเขียว, ตัวเครื่องจะปรับไฟกั๊สทางคนไข้ และทำการวัดความดันสูกตาของคนไข้ โดยอัตโนมัติ (Auto Start) และเมื่อวัดตาข้างขวาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็ทำการโยก Joy Stick มาทำการวัดตาข้างซ้ายของคนไข้ และเมื่อได้ผลการวัดความดันตาทั้ง ๒ ข้างแล้ว เครื่องจะพิมพ์ผลการวัดออกมานอกเครื่องโดยอัตโนมัติ (Auto Print)
  - ๓.๙ ผู้ใช้สามารถใส่ค่าความหนาของกระจากตา (Central Corneal Thickness : CCT) เข้าไป เพื่อให้เครื่องช่วยคำนวณหาค่าความดันตาที่มีการซัดเชยค่าความหนาของกระจากตา อันจะทำให้ได้ค่าความดันภายในสูกตาที่แม่นยำมากขึ้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากฐาน		
๑. นางทิพปภา ภุลินทรประเสริฐ (ลงชื่อ).....	๒. นางสิริชัย ปันแก้ว (ลงชื่อ).....	๓. นายทองคำ ใบโพธิ์ (ลงชื่อ).....


- ๓.๑๐ ตัวเครื่องมีระบบควบคุมแรงดันของลมเป่า (Smart Puffing Control System : S.P.C) เพื่อปรับแรงดันของลมเป่าให้เหมาะสมกับความดันภายในลูกตาของคนใช้, และยังช่วยให้เสียงเบายิ่งขึ้น
- ๓.๑๑ มีระบบป้องกันอุบัติเหตุ (Safety Functions) ไม่ให้หัวพ่นลมไปกระแทกกับกระจกตาของคนใช้ได้, โดยเมื่อผู้ใช้เดินเครื่องเข้าไปใกล้ตาคนใช้มากเกินไป จะมีตัวอักษร คำว่า "Too Close" ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ และมีสัญญาณเสียงปีปีเพื่อเตือน
- ๓.๑๒ มีปุ่มสำหรับทดสอบการทำงาน ของระบบพ่นลม
- ๓.๑๓ มีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่อง, มีระบบการพิมพ์ผลการวัดโดยอัตโนมัติเมื่อทำการวัดตาทั้งสองข้างเสร็จ (Automatic Print), และพิมพ์ผลการวัดอย่างรวดเร็ว (Quick Printer), เครื่องพิมพ์เป็นแบบ Thermal Printer โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด ๕๕ มิลลิเมตร, โดยสามารถพิมพ์ผลการวัด, สรุปค่าผลการวัด, วัน, เดือน, ปี, เวลา, ลำดับที่, ชื่อของหน่วยงานที่ทำการวัด, โดยสามารถถ่ายให้เครื่องพิมพ์ผลการวัด ก็ได เพื่อประทับตราโดย
- ๓.๑๔ มีช่องต่อส่งข้อมูลแบบ RS-๒๓๒
- ๓.๑๕ ตัวเครื่องวัดความดันตามมาตรฐาน กว้าง ๒๔๐ x สูง ๔๗๒ x ลึก ๕๓๐ มิลลิเมตร, มีน้ำหนักประมาณ ๑๓ กิโลกรัม
- ๓.๑๖ ไฟไฟฟ้าขนาด ๑๐๐-๒๔๐ โวลท์, ๕๐ / ๖๐ เฮิร์ทซ์, ๖๐ VA

#### ๔. อุปกรณ์ประกอบ

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๔.๑ ตัวเครื่อง                                   | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔.๒ ฝาสำหรับปิดช่องลม                            | จำนวน ๑ อัน     |
| ๔.๓ กระดาษพิมพ์                                  | จำนวน ๒ ม้วน    |
| ๔.๔ กระดาษรองคง                                  | จำนวน ๑๐๐ แผ่น  |
| ๔.๕ ถุงคลุมเครื่อง                               | จำนวน ๑ ใบ      |
| ๔.๖ คู่มือการใช้งาน และบัญชีรายการเป็นภาษาอังกฤษ | จำนวน ๑ เล่มๆ   |
| ๔.๗ โต๊ะวางอุปกรณ์ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า       | จำนวน ๑ ตัว     |
| ๔.๘ เก้าอี้มีพนักพิงแบบล้อเลื่อน                 | จำนวน ๑ ตัว     |
| ๔.๙ เก้าอี้กลมแบบล้อเลื่อน                       | จำนวน ๑ ตัว     |
| ๔.๑๐ เครื่องสำรองไฟ                              | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔.๑๑ กระเบ้าสำหรับใส่เครื่องแบบล้อเลื่อน         | จำนวน ๑ เครื่อง |

#### คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๑. นางทิพภานุ ภูมิธรรมประเสริฐ (ลงชื่อ).....  
 ๒. นางศิริชวัญ ปันแก้ว (ลงชื่อ).....  
 ๓. นายทองคำ ใบโพธิ์ (ลงชื่อ).....


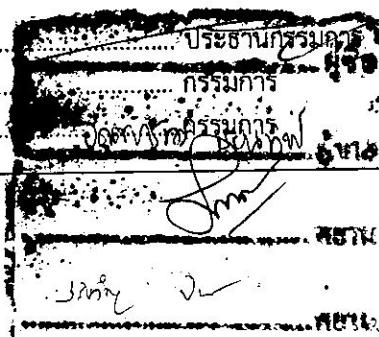


#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบสินค้า
- ๕.๓ ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯผู้ผลิตและหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา
- ๕.๔ เพื่อความเชื่อมั่นด้านงานดูแล การบริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาต้องดำเนินกิจการด้านเครื่องมือแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแคตตาล็อก ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมตารางลงรายละเอียดเปรียบเทียบ และทำเครื่องหมายลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

#### คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- |                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| ๑. นางทิพปภา ถุลินทรประเสริฐ | (ลงชื่อ)..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางศิริชวัญ ปั่นแก้ว      | (ลงชื่อ)..... | กรรมการ       |
| ๓. นายทองคำ ใบโพธิ์          | (ลงชื่อ)..... | กรรมการ       |

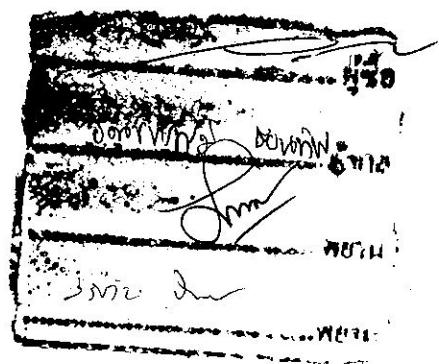
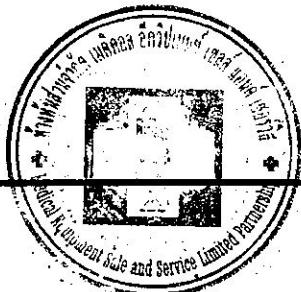


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง

๑. ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงพร้อมอุปกรณ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัดถูประ斯顿์การใช้งาน สำหรับใช้ตรวจผู้ป่วย
๓. คุณลักษณะทั่วไป
  - ๓.๑ พิกัดกำลัง ๒๐๐ Kg
  - ๓.๒ ค่าละเอียด ๕๐ g (๐.๕ Kg)
  - ๓.๓ ตัวเลข LED สีขาวสูง ๓๕ mm
  - ๓.๔ พื้นที่ชั่ง: ๓๕๕ x ๓๕๐ mm
  - ๓.๕ อุปกรณ์วัดส่วนสูง : ๘๗-๒๑๐ cm ความละเอียด ๐.๑ cm
  - ๓.๖ ระบบสื่ยงบอกน้ำหนักเป็นภาษาไทย (เมื่อต้องการเปิด-ปิดเสียง กดปุ่ม VOICE SWITCH)
  - ๓.๗ พลังงาน : Rechargeable battery , AC ๒๒๐V (๕V/๕๐๐mA หรือ ๖V/๕๐๐mA DC Adapter)
  - ๓.๘ มาตรฐาน ISO ๘๐๐๑
  - ๓.๙ เพื่อความเชื่อมั่นด้านดูแล การบริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาต้องดำเนินกิจการด้านเครื่องมือแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
  - ๓.๑๐ รับประกันคุณภาพ อย่างน้อย ๑ ปี
  - ๓.๑๑ ผู้เสนอราคากำหนดต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย
  - ๓.๑๒ ผู้เสนอราคากำหนดต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแคดดาลีค ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมตารางลงรายละเอียดเปรียบเทียบ และทำเครื่องหมายลงหมายเลข ข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาภายนอก

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| ๑. นางสาวกนกรณ ตันติฤทธิพ (ลงชื่อ)..... | กานกรณ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางรติชยา แก้วกันใจ (ลงชื่อ).....    |             | กรรมการ       |
| ๓. นางกนกรณ ชนันชัย (ลงชื่อ).....       |             | กรรมการ       |

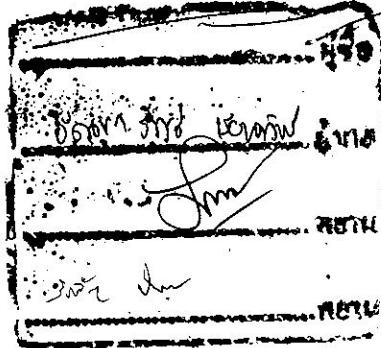



หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส  
40/15 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ 053-274997, 328032 โทรสาร 053-277102 E-mail : sales.mes43@gmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องวัดความดันถุงค่าแบบไม้สัมผัสกระจากต้า  
ยี่ห้อ Shin Nippon รุ่น NCT-200



1. วัดถูกประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องวัดความดันถุงค่าระบบอัตโนมัติ แบบไม้สัมผัสชนิดใช้ลมเป่า
2. รายละเอียดทั่วไป
  - 2.1 เป็นเครื่องวัดความดันถุงค่าระบบอัตโนมัติ แบบไม้สัมผัส ชนิดใช้ลมเป่า
  - 2.2 มีเครื่องพิมพ์ในตัว
  - 2.3 ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮริทซ์
3. รายละเอียดทางเทคนิค
  - 3.1 มีระบบการวัด 3 แบบ คือ (1) ระบบ Auto (2) ระบบ Auto แบบสามารถกำหนดจำนวนครั้ง (3) ระบบ Manual
  - 3.2 มีช่วงการวัด 1-60 mmHg, มีความละเอียดในการวัดขั้นละ 1 mmHg หรือ 0.1 ถึง 8.0 kPa มีความละเอียดในการวัด ขั้นละ 0.1 kPa
  - 3.3 ระยะในการทำงานของเครื่อง (Working Distance) ประมาณ 11 มิลลิเมตร
  - 3.4 มีไฟเบื้ามองให้กันไข้มองจากภายใน (Internal Target) ของช่องลมเป่า โดยสามารถตั้งไฟเบื้ามองให้เป็นแบบติดก้าง หรือ แบบกระพริบ ได้
  - 3.5 มีที่วางของคนไข้ สามารถปรับขึ้นลงได้
  - 3.6 มี Joy Stick เพียงอันเดียว สามารถปรับตัวโดยตัวเครื่อง ให้เดินหน้า-ถอยหลัง, เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย-ขวา, และเลื่อนขึ้นบน-ล่างได้
  - 3.7 มีจอแสดงภาพแบบจอ LCD สำหรับขนาด 5.7 นิ้ว, สามารถปรับระดับความสูงต่ำของจอภาพให้ก้ม-งอได้ 40 องศา, ซ้าย-ขวาได้ 30 องศา เพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้วัด, สามารถแสดงการปรับระดับไฟก๊าซ, ผลการวัด, ค่าสรุป และข้อมูลต่างๆ และจอภาพสามารถตัดไฟออกเมื่อไม่ใช้เครื่อง (Power Saving Function) ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งได้ 3, 5, 10 นาที หรือไม่ให้自動关机





หจก.เมคิดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส  
40/15 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทร 053-274997, 328032 โทรสาร 053-277102 E-mail : sales.mes43@gmail.com

- 3.8 เมื่อผู้ใช้ทำการปรับเครื่อง ให้เครื่องหมายสีเหลี่ยมของเครื่องตรงกับตาคำของคนไข้ และทำการโยก Joy Stick เดินหน้า จนกระทั่งเครื่องหมายสีเหลี่ยมเป็นสีเขียว, ตัวเครื่องจะปรับไฟกัลตาของคนไข้ และทำการวัดความดันสูกตาของคนไข้ โดยอัตโนมัติ (Auto Start) และเมื่อวัดตาข้างขวาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็ทำการโยก Joy Stick มาทำการวัดตาข้างซ้ายของคนไข้ และเมื่อได้ผลการวัดความดันตาทั้ง 2 ข้างแล้ว เครื่องจะพิมพ์ผลการวัดออกมาให้อัตโนมัติ (Auto Print)
- 3.9 ผู้ใช้สามารถใส่ค่าความหนาของกระจกตา (Central Corneal Thickness : CCT) เข้าไป เพื่อให้เครื่องช่วยคำนวณหาค่าความดันตาที่มีการขาดเชยค่าความหนาของกระจกตา อันจะทำให้ได้ค่าความดันภายในสูกตาที่แม่นยำมากขึ้น
- 3.10 ตัวเครื่องมีระบบควบคุมแรงดันของลมเป่า (Smart Puffing Control System : S.P.C) เพื่อปรับแรงดันของลมเป่าให้เหมาะสม กับความดันภายในสูกตาของคนไข้, และบังช่วยให้เสียงเบาขึ้น
- 3.11 มีระบบป้องกันอุบัติเหตุ (Safety Function) ไม่ให้หัวพ่นลมไปกระแทกกับกระจกตาของคนไข้ โดยสามารถกำหนดระยะห่างของหัวพ่นลมกับกระจกตาของคนไข้ได้ โดยเมื่อผู้ใช้เดินเครื่องเข้าไปใกล้ตากคนไข้มากเกินไป จะมีตัวอักษร คำว่า "Too Close" ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ และมีสัญญาณเสียงปี๊ดเตือน
- 3.12 มีปุ่มสำหรับทดสอบการทำงาน ของระบบพ่นลม
- 3.13 มีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่อง, มีระบบการพิมพ์ผลการวัดโดยอัตโนมัติเมื่อทำการวัดตาทั้งสองข้างเสร็จ (Automatic Print), และพิมพ์ผลการวัดอย่างรวดเร็ว (Quick Printer), เครื่องพิมพ์เป็นแบบ Thermal Printer โดยใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด 58 มิลลิเมตร, โดยสามารถพิมพ์ผลการวัด, สรุปค่าผลการวัด, วัน, เดือน, ปี, เวลา, ลำดับที่, ชื่อหน่วยงานที่ทำการวัด, โดยสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์ผลการวัด หรือไม่พิมพ์ผลการวัดก็ได้ เพื่อประหยัดกระดาษ
- 3.14 มีช่องต่อส่งข้อมูลแบบ RS-232
- 3.15 ตัวเครื่องวัดความดันตา มีขนาด กว้าง 240 x สูง 430 มิลลิเมตร, มีน้ำหนักประมาณ 13 กิโลกรัม
- 3.16 ใช้ไฟฟ้าขนาด 100-240 โวลท์, 50/60 เฮิร์ทซ์, 60 VA

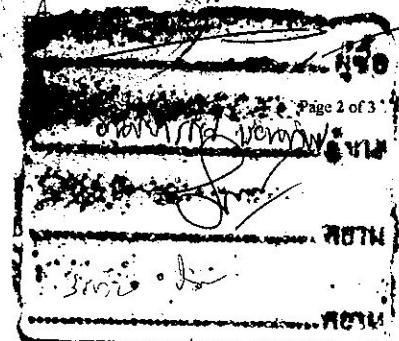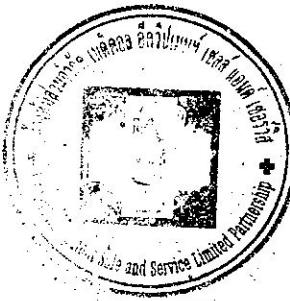



หจก.เมคิคอล อีคิวป์เม้นท์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

40/15 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร 053-274997, 328032 โทรสาร 053-277102 E-mail : sales.mes43@gmail.com

#### 4. อุปกรณ์ประกอบ

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 4.1 ตัวเครื่อง                                  | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4.2 ฝาสำหรับปิดช่องลม                           | จำนวน 1 อัน     |
| 4.3 กระดาษพิมพ์                                 | จำนวน 2 ม้วน    |
| 4.4 กระดาษรองคาง                                | จำนวน 100 แผ่น  |
| 4.5 ถุงคุณภาพร้อน                               | จำนวน 1 ใบ      |
| 4.6 คู่มือการใช้งาน และนำรูงรักษาเป็นภาษาอังกฤษ | จำนวน 1 ตัว     |
| 4.7 โต๊ะวางอุปกรณ์ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า      | จำนวน 1 ตัว     |
| 4.8 เก้าอี้มีพนักพิงแบบล้อเลื่อน                | จำนวน 1 ตัว     |
| 4.9 เก้าอี้ลมแบบล้อเลื่อน                       | จำนวน 1 ตัว     |
| 4.10 เครื่องสำรองไฟ                             | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4.11 กระเบื้องสำหรับใส่เครื่องแบบล้อเลื่อน      | จำนวน 1 เครื่อง |

#### 5. เสื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
- 5.2 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบสินค้า
- 5.3 ผู้นำเข้ามา มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิตและหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมุดอายุ ณ วันเสนอราคา
- 5.4 เพื่อความเชื่อมั่นด้านงานคุณภาพ การบริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาต้องดำเนินกิจการด้านเครื่องมือแพทย์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี
- 5.5 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแกตตาล็อก ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมตารางลงรายละเอียดเบริร์บเที่ยบ-และทำเครื่องหมายลงหมายเลขอ้างอ้างตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

1. ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูงพร้อมอุปกรณ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. วัสดุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้ตรวจผู้ป่วย

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 น้ำหนัก 200 kg ✓

3.2 ค่าละเอียด 50 g (0.5 kg) ✓

3.3 ตัวเลข LED สีขาวสูง 35 mm ✓

3.4 พื้นที่ชั้น: 345x380 mm ✓

3.5 อุปกรณ์วัดส่วนสูง : 83-210 cm ความละเอียด 0.1 cm ✓

3.6 ระบบเสียงบอกน้ำหนักเป็นภาษาไทย (เมื่อต้องการเปิด-ปิดเสียง กดปุ่ม VOICE SWITCH) ✓

3.7 พลังงาน : Rechargeable battery , AC 220V (5V/500mA หรือ 6V/500mA DC Adapter) ✓




3.8 มาตรฐาน ISO 9001 ✓

3.9 เพื่อความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ การบริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาต้องดำเนินกิจการด้านเครื่องมือแพทย์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี ✓

3.10 รับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี ✓

3.11 ผู้เสนอราคากำลังต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ✓

3.12 ผู้เสนอราคาก่อต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแคตตาล็อก ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมตารางลงรายละเอียดเบรียบเที่ยบ แล้วที่เอกสารนี้หมายลง หมายเลข ข้อให้ทราบรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ✓

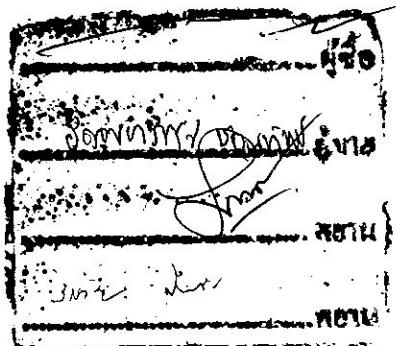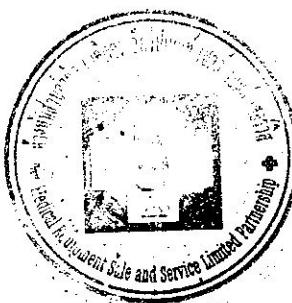


# Rexxam

Quality in vision care

## NCT-200

Non-Contact Tonometer 2.1

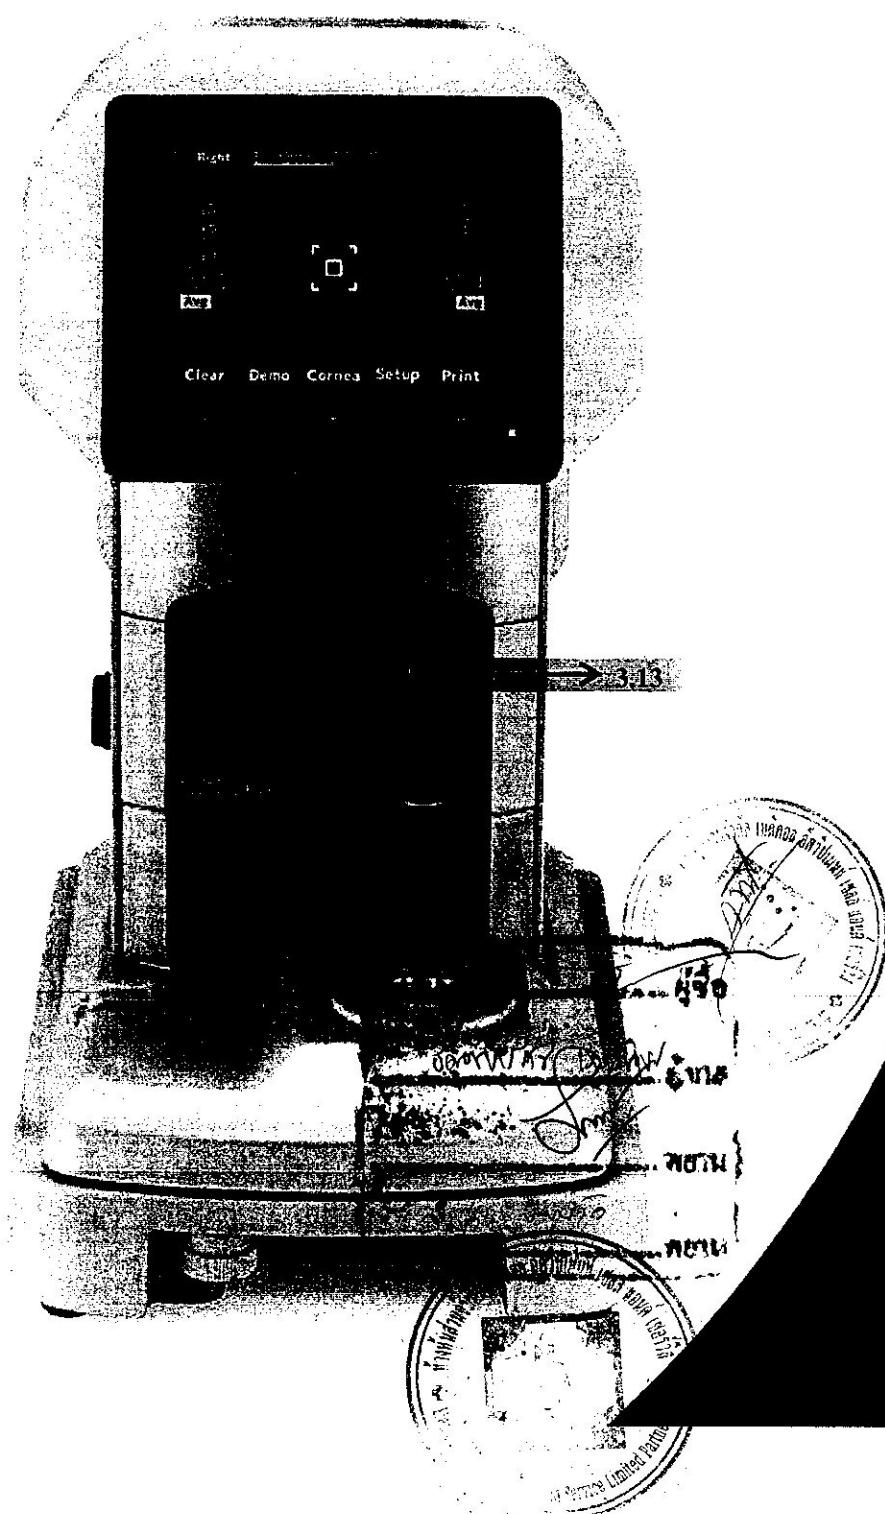

## About Us

### Rex + Max = Rexxam


Rexxam, which means 'the king of the kings', is a respected and reliable brand.

Rexxam is a Japanese company with a celebrated 60 year history. With over 3,000 employees worldwide, Rexxam manufacture a wide range of products for various industries; from factory automation, automobiles and air conditioning systems, to beer and ski boots.

Since 1986, Rexxam has manufactured various high quality products for leading brands in the eye care industry, including SHIN-NIPPON. Rexxam had developed and manufactured products for SHIN-NIPPON since 1993 and in 2014 the company took over the SHIN-NIPPON brand.

We will be bringing high quality ophthalmic equipment to a global market. By combining precision engineering with industry leading innovation and experience in mass production, Rexxam produce unique products to support eye care specialists across the world.


Quality in vision care, we are Rexxam.

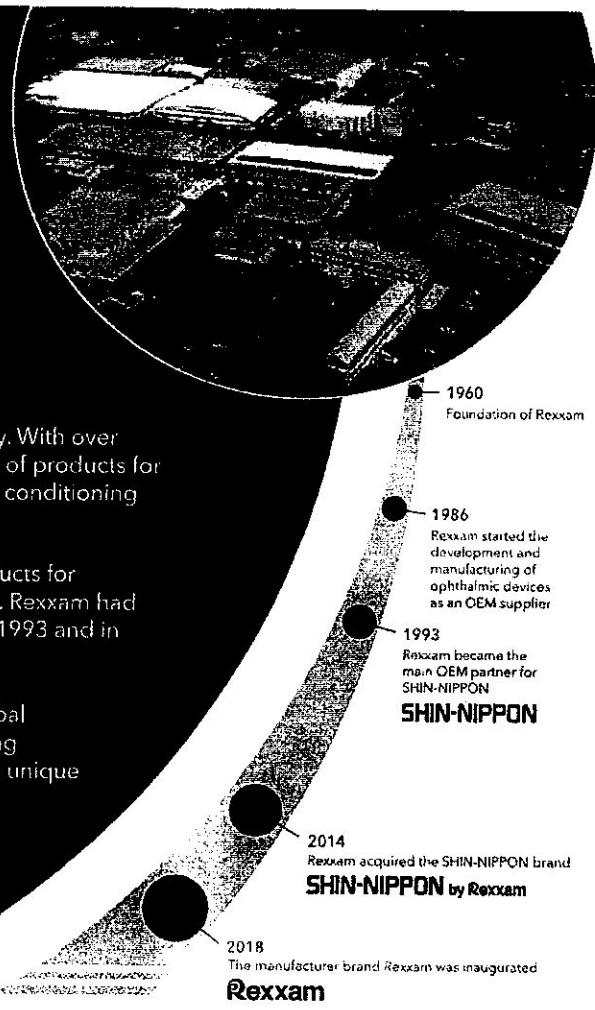

# Rexxam

Quality in vision care

Proudly Made in Japan

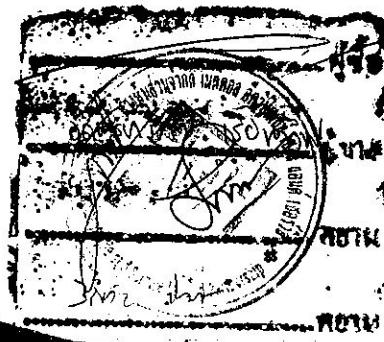


# Compact & Ergonomic Design with Simple Opreration.

The air puff of Rexxam's Non-Contact Tonometer is gentle and quiet which minimises patient anxiety during measurement. Alignment is swift and easy to operate.

Through the pursuit of ergonomics and attention to detail combined with optimal material selection, Rexxam has achieved a compact design with superb operability and solid reliability.



- Smart Puff Control system (SPC)
- IOP correction function
- Small footprint
- Easy alignment with auto measurement
- On-board thermal printer
- Safty stop

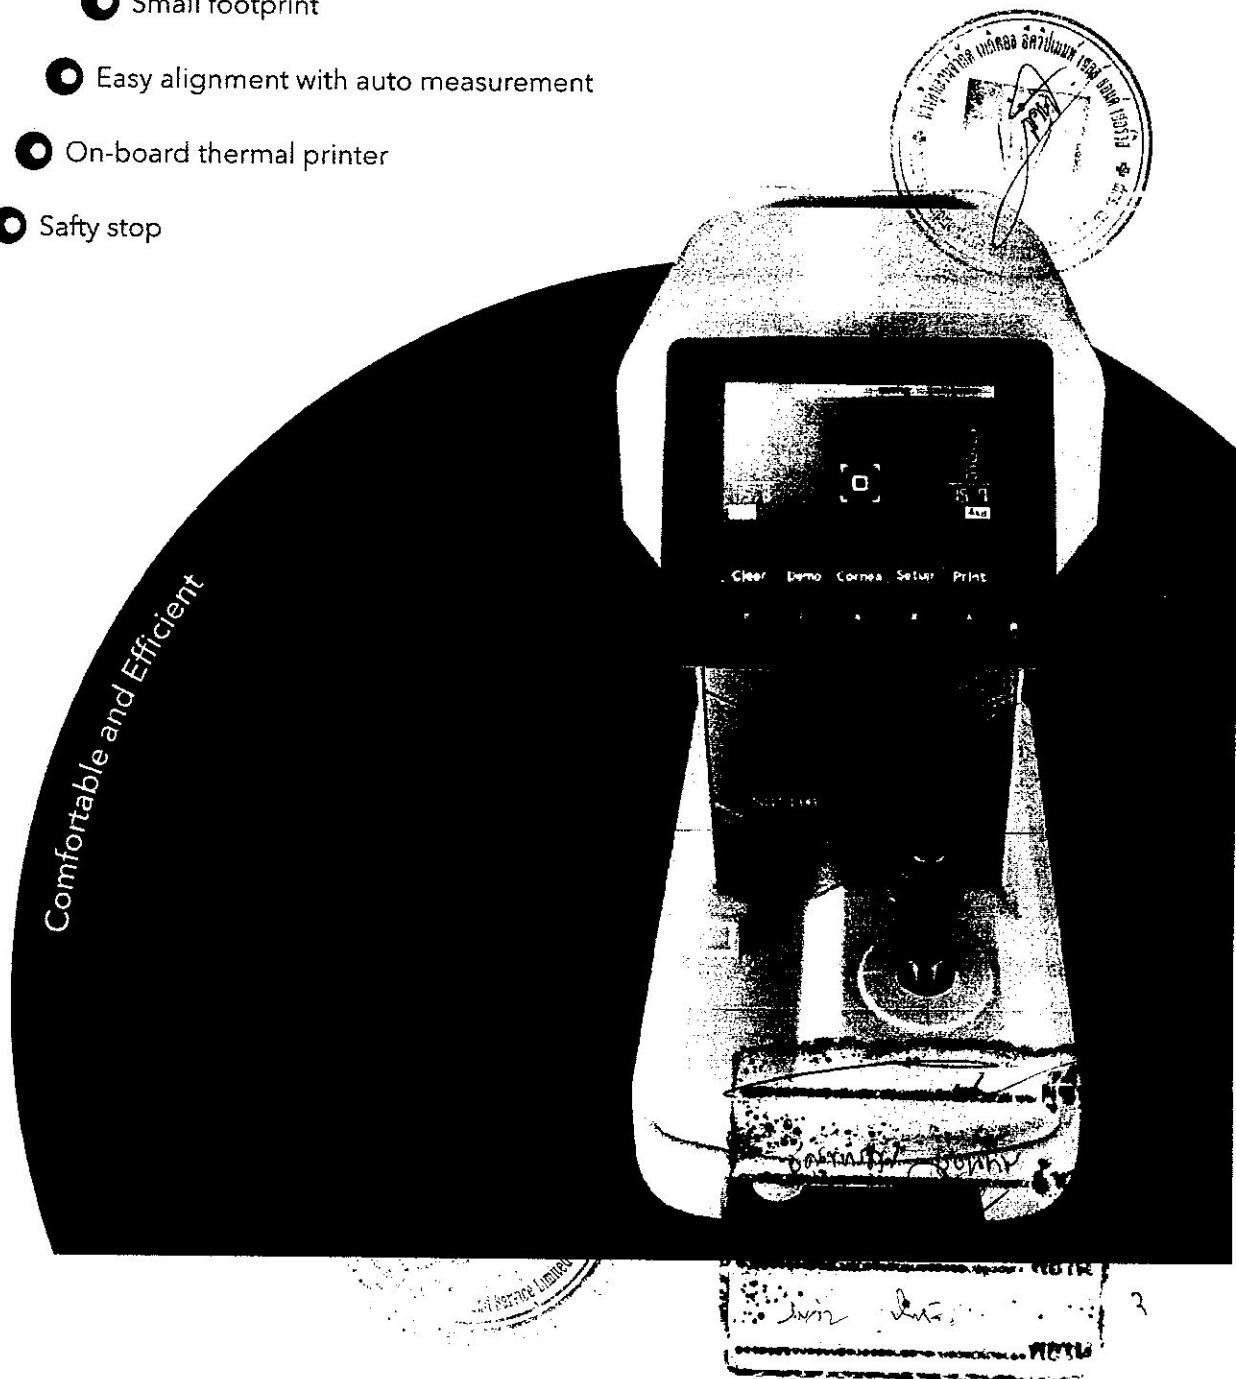

## NCT-200 Performance


### Optimum monitor tilting and swivel angles

The monitor 30° left swivel allows user to assist patient position whilst operating the joystick. The 40° vertical tilt provides convenient operation in either a standing or sitting position.

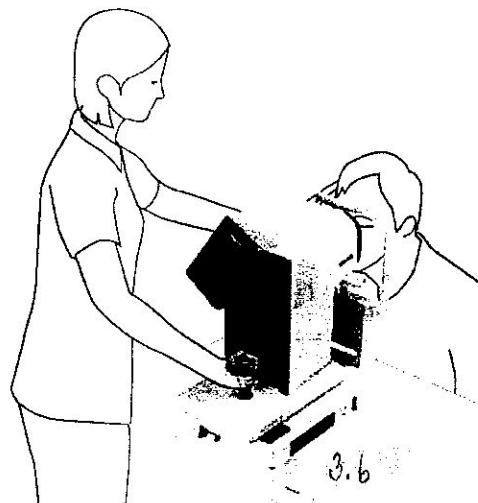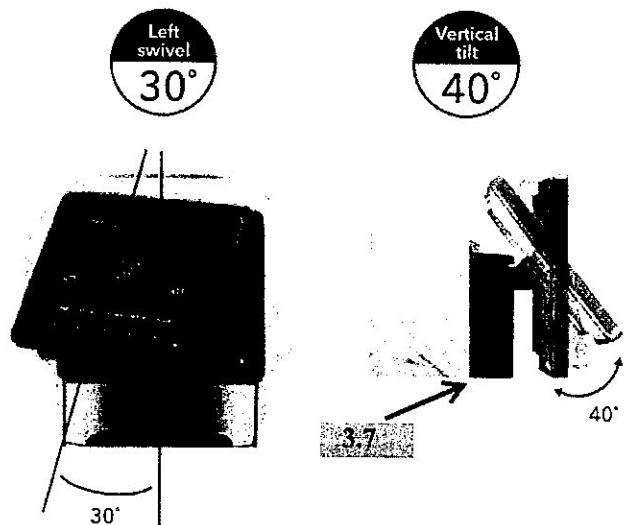


### Smart Puff Control system (SPC) 3.11

The SPC system includes a newly developed algorithm measurement engine that instantly and precisely adjusts its air pressure to match patient's intraocular pressure (IOP). This unique soft air circuit enhances patient comfort.




### Smart Alignment & Auto Shoot function 3.8

Smooth and accurate alignment function.  
Once aligned, automatic air puff measurement begins.  
Smooth and speedy operation that minimises patient anxiety.

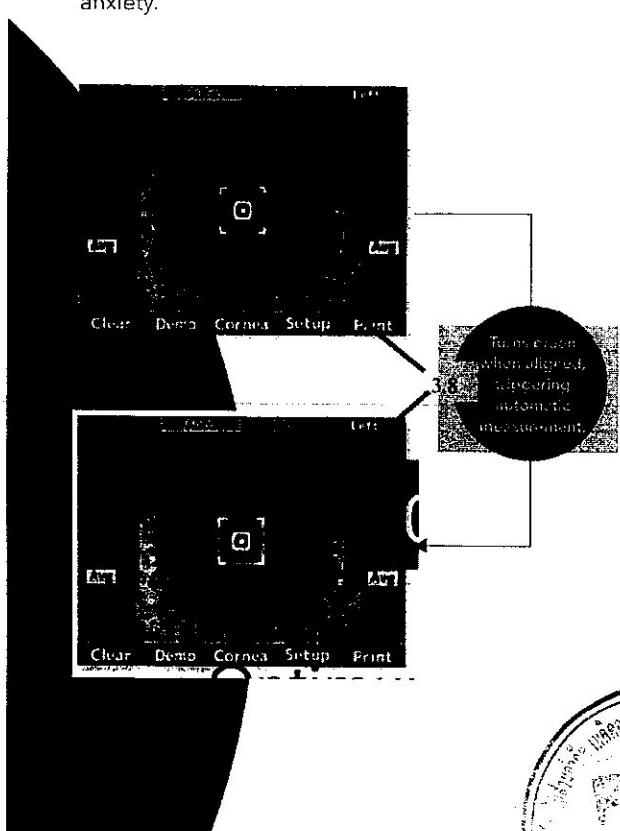

### IOP Correction Function 3.9



The IOP value is automatically corrected (Corr.) by the input of the central corneal thickness measurements. The correction can be made either before or after measurement.

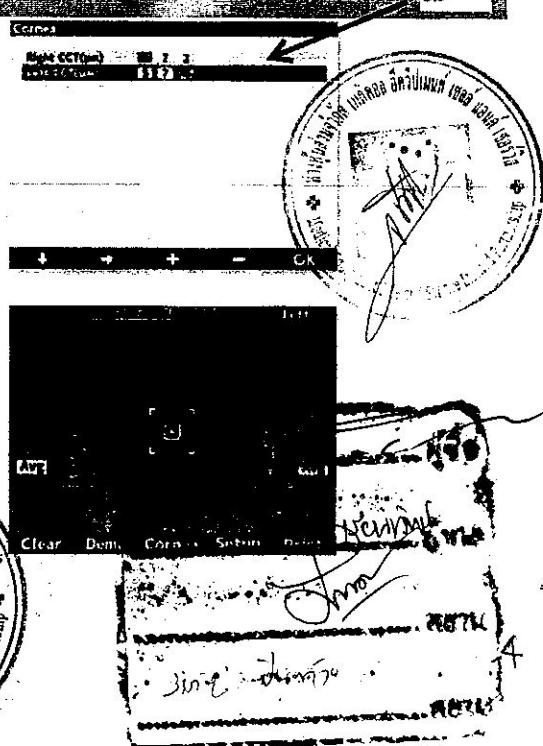

## Triple safety system

3.11

The safety stopper prevents the nozzle from coming in contact with the patient's eye. Just in case the safety stopper is not properly locked in position, an alert "Beep" sound triggers and warning message "Beep" also appears on the monitor.

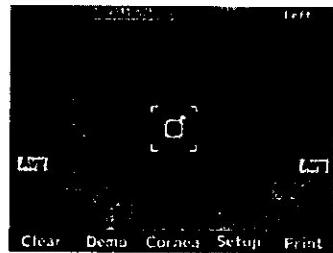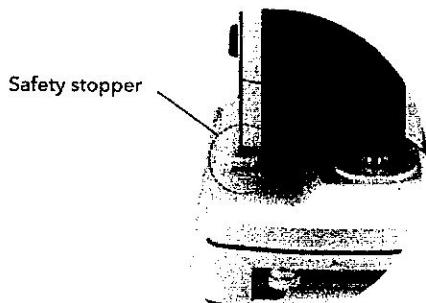


## Capacitive touch sensor buttons

The capacitive touch sensor buttons work responsively whilst keeping the main screen clear from fingerprints, etc.




## Intuitive joystick operation

The solid and ergonomic joystick ensures intuitive, comfortable and smooth operation.



## Breath shield


A dedicated breath shield is available for hygiene or social distancing purposes.  
(Optional)

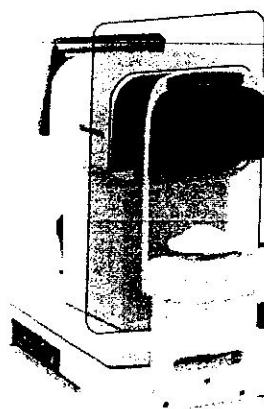

5

## Reliability warning mark

The smart warning mechanism displays an asterisk (\*) on screen as well as on the printout, to indicate when the measured value has low reliability.

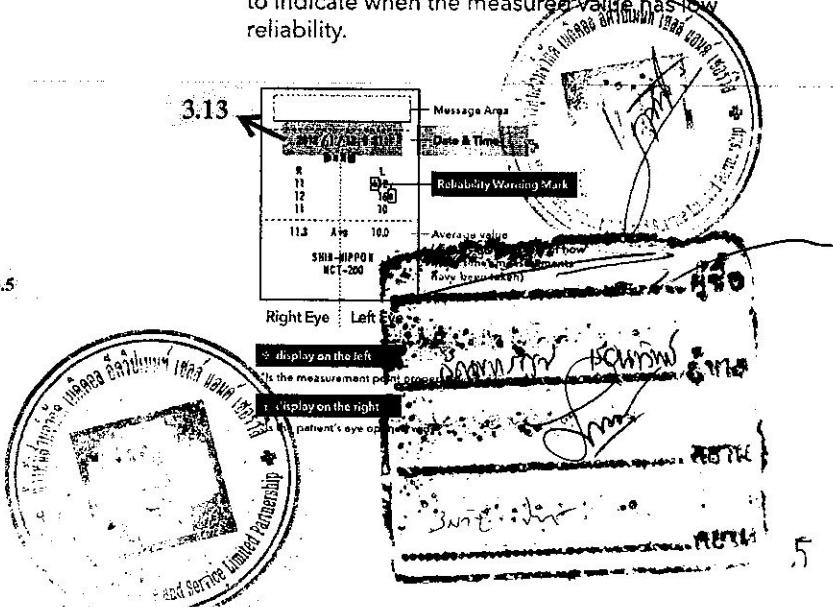

5

# NCT-200 Specifications

Intraocular Pressure(IOP) Measurement Range	1mmHg ~ 60mmHg / 0.1kPa ~ 8.0kPa 3.2
Measurement Resolution	1mmHg / 0.1kPa 3.2
Working Distance	11mm~33mm
Target	Fixation Light : Green (Blinking / Non-Blinking selectable) 3.4
Start-up Method	Manual, Automatic 3.1
IOP Correction Function	With a corneal thickness input function
Monitor	Color liquid crystal LCD monitor 3.7
2.2 Power	External AC power source Power Voltage : AC 100 ~ 240V, 50/60Hz 2.3, 3.16 Power Consumption : 60VA 3.16 Power Saving Function : OFF, 3.5, 10 min. (selectable) 3.7
Data Output	R2-32C interface
Size	Weight : approx. 13kg 3.5 Dimensions : 240mm(W) x 422mm(D) x 430mm(H) 3.15
Movement Range of The Measurement Unit	Forward - Backward : ±22mm Right - Left : ±43mm Up - Down : ±17mm
Movement Range of The Chin Rest	Up - Down : ±30mm 3.5
Movement Range of LCD	Swivel Left 30° 3.7 Vertical Tilt Up 40°

## Standard Accessories




- Measuring Nozzle Cap
- Printer Roll Paper
- Chin Rest Paper
- Chin Rest Paper Pin
- Spare Fuse
- Dust Cover

Design and specifications are subject to change without notice.

## Manufacturer


**Rexxam**  
Quality in vision care

Rexxam Co.,Ltd.  
Kagawa factory  
958 Ikeyuchi, Konan-cho,  
Takamatsu-shi, Kagawa-ken,  
761-1494 Japan

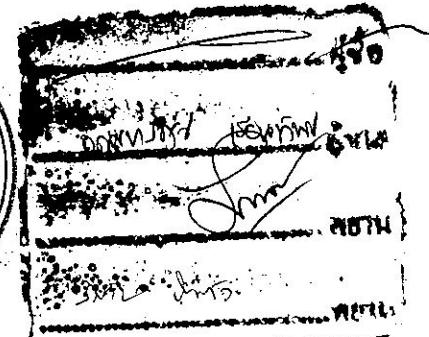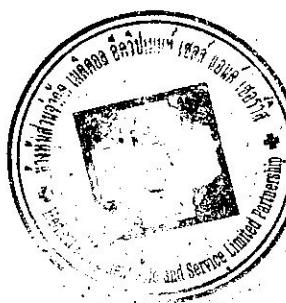


## 6 Wiring Diagram



### 6-1 Front View

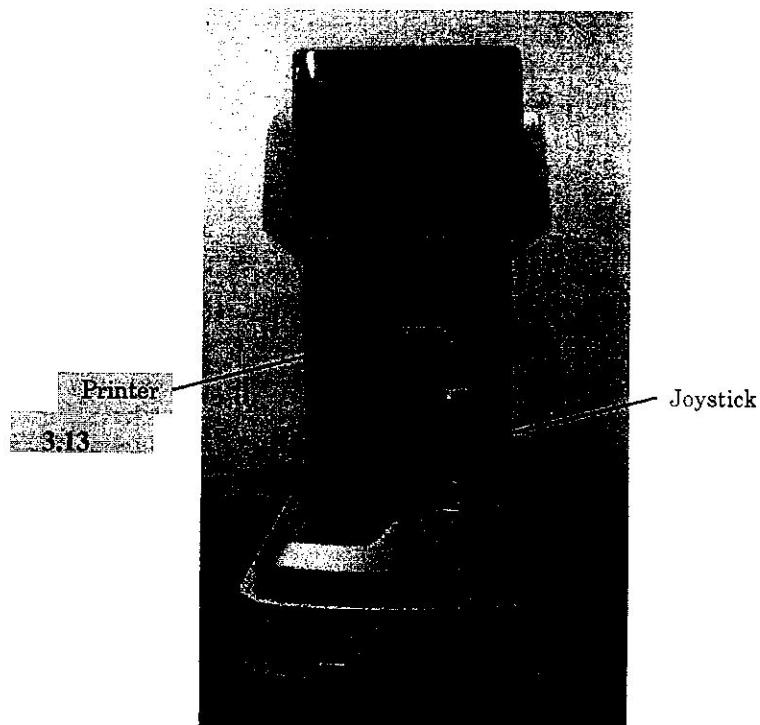

### 6-2 Side View

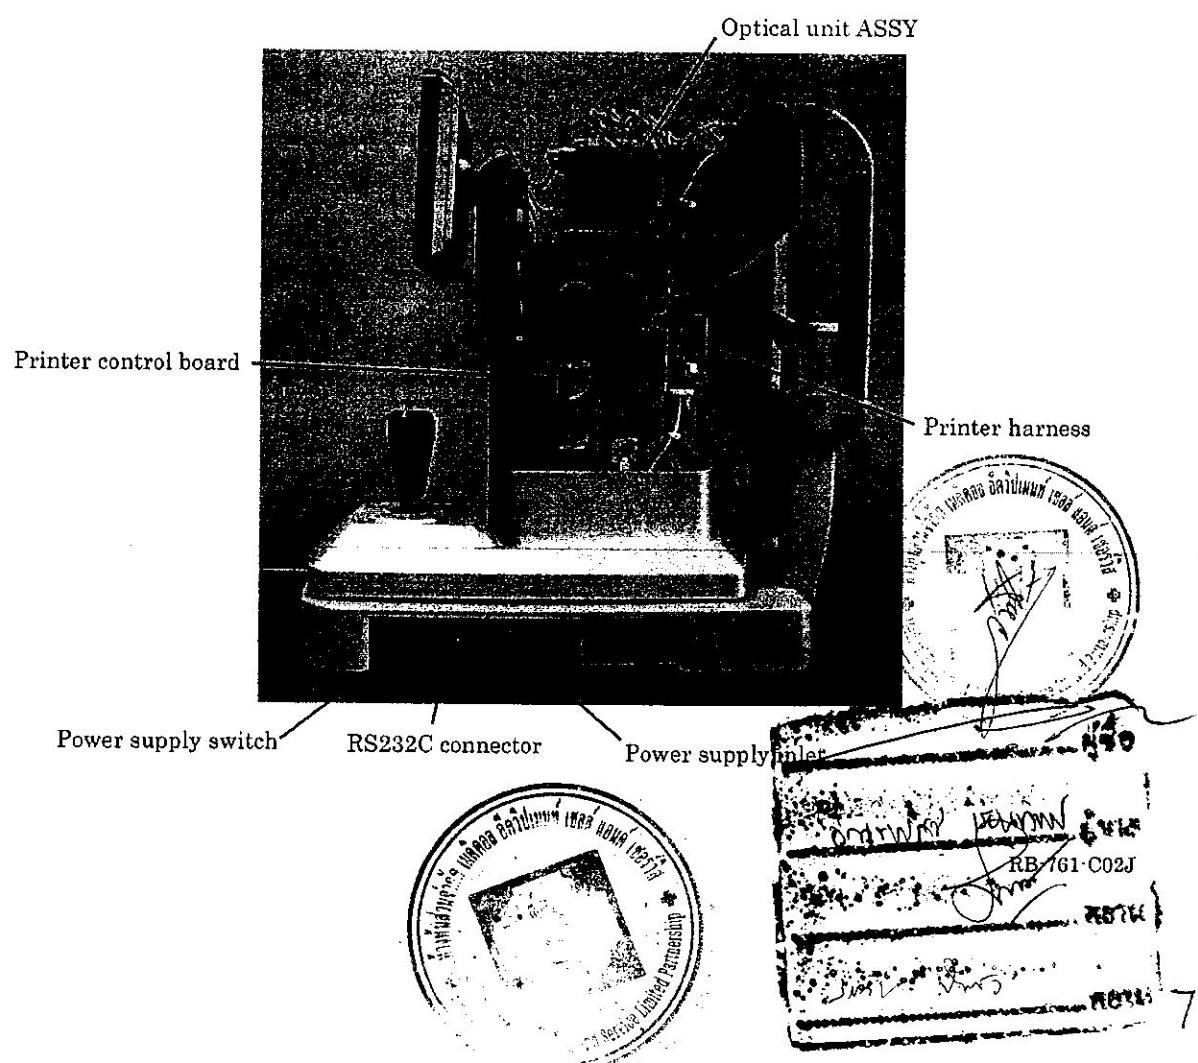


## 2.2 ส่วนประกอบ

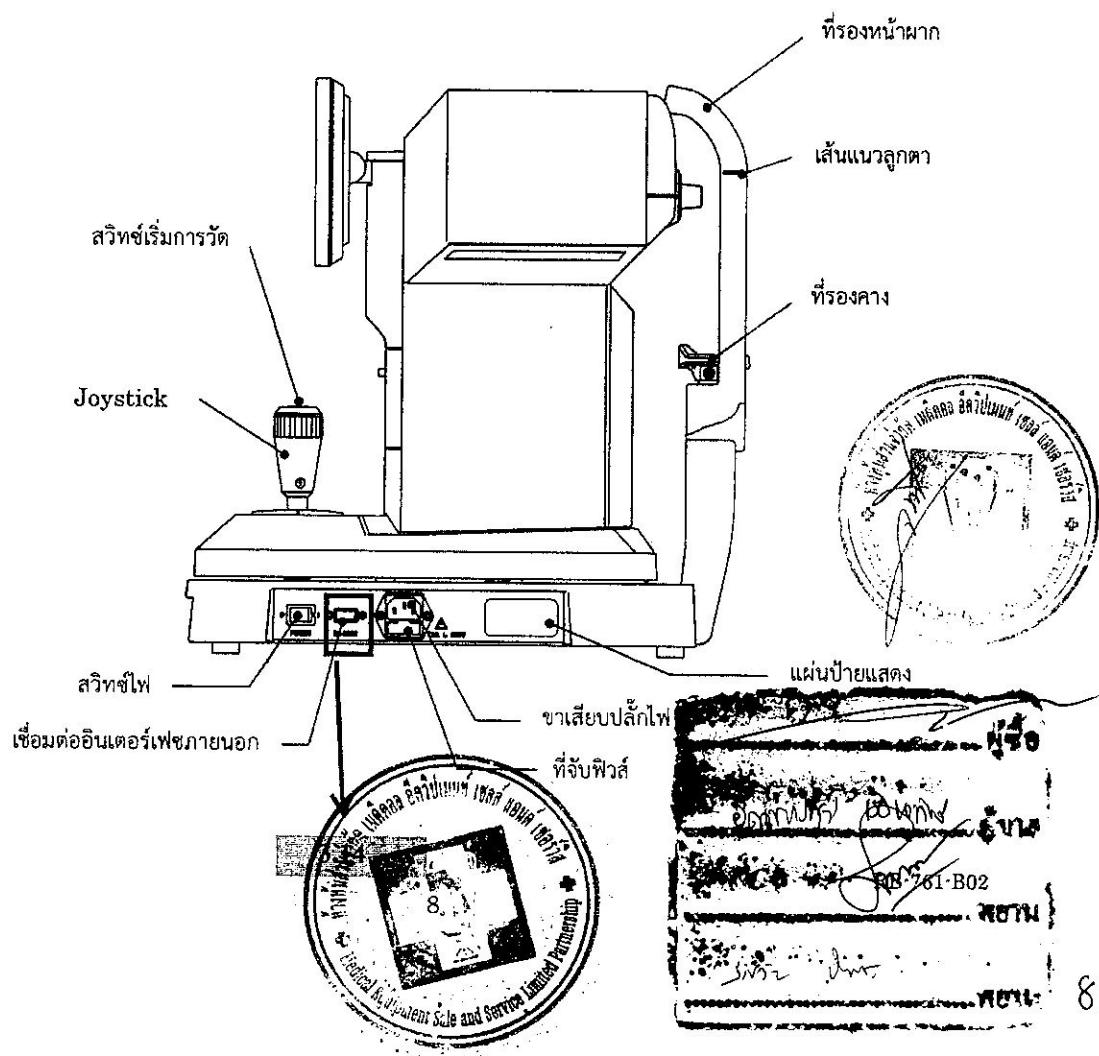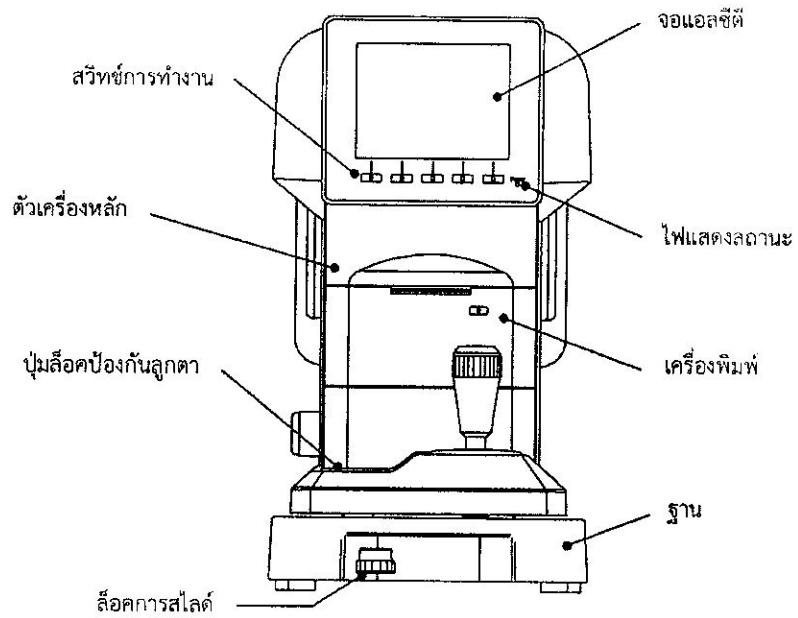


#### 4.3.3 แสดงตัวบาย

เมื่อเปิดไฟ หน้าจอที่แสดงตั้งด้านซ้ายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแอลซีดี ซึ่งพร้อมสำหรับการวัด

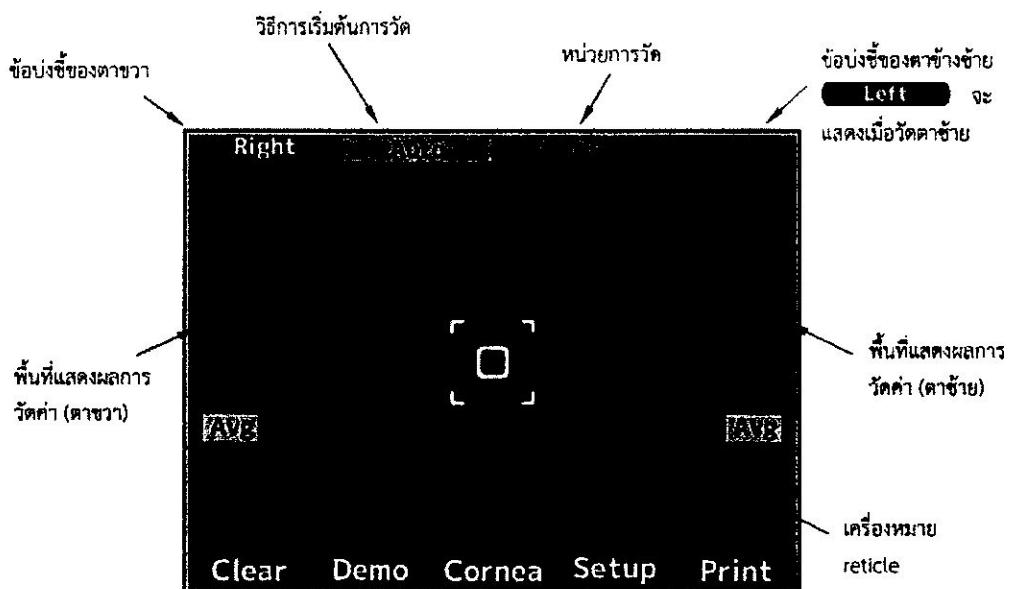


ไอคอน		ฟังก์ชัน
Right		ระบุตา (ซ้ายขวาหรือซ้ายขวา) ในกระบวนการของการวัด
Setup		ระบุวิธีการวัด อัตโนมัติหรือวัดด้วยมือ
Unit		ระบุหน่วยของค่าการวัด (mmHg หรือ kPa)
Clear		ลบค่าการวัด (ข้อมูลหน่วยความจำจะถูกลบโดยการกดปุ่มลับทิ้ง)
Demo		เป้าหมายทดสอบหน้างานที่เปลี่ยนการวัดจริง 3.12
Cornea		เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขความหนาของกระฉกรดา
Setup		เปลี่ยนเป็นโหมดการตั้งค่าหน้าจอ
Print		พิมพ์ผลการวัด

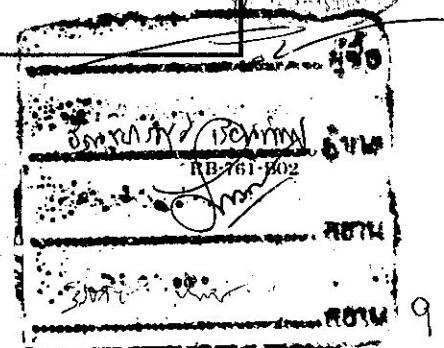


#### 4.4 การตั้งค่าของหน้าจอการตั้งค่า

หมายเหตุการตั้งค่าฐานเป็นที่ดีกว่ามีความพร้อมสำหรับการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสามารถทำได้อย่างง่ายดายถ้าจำเป็น กดลิฟต์ **Setup** ภายใต้จอมออลซีดและแสดงหน้าจอการตั้งค่า

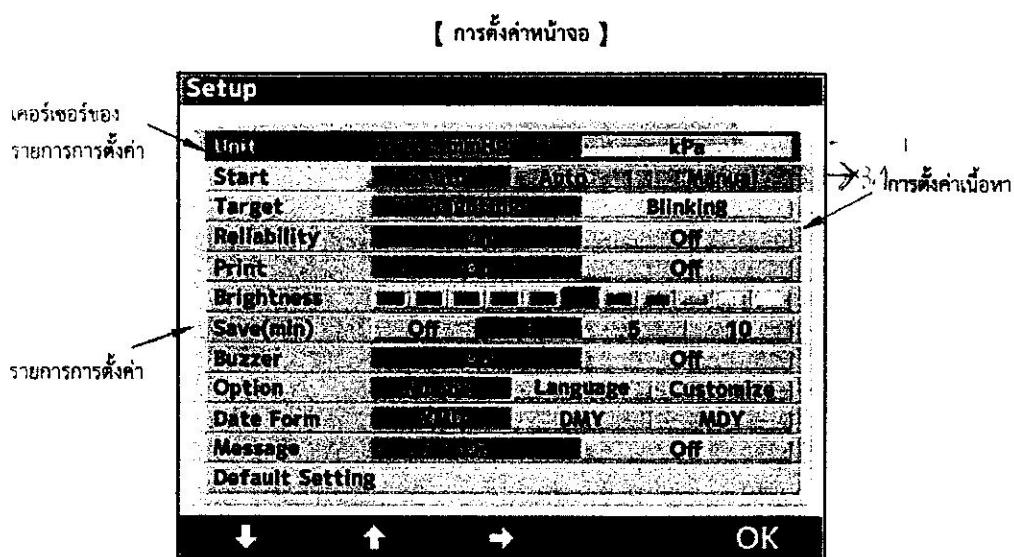

มี 12 รายการการตั้งค่าบนหน้าจอการตั้งค่า  
เลือกรายการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการกด **↓** หรือ **↑** และเปลี่ยนได้  
โดยการกด **→**  
หลังจากการเปลี่ยนแปลง กดปุ่ม **OK** และข้ายกลับไปที่หน้าจอการวัด

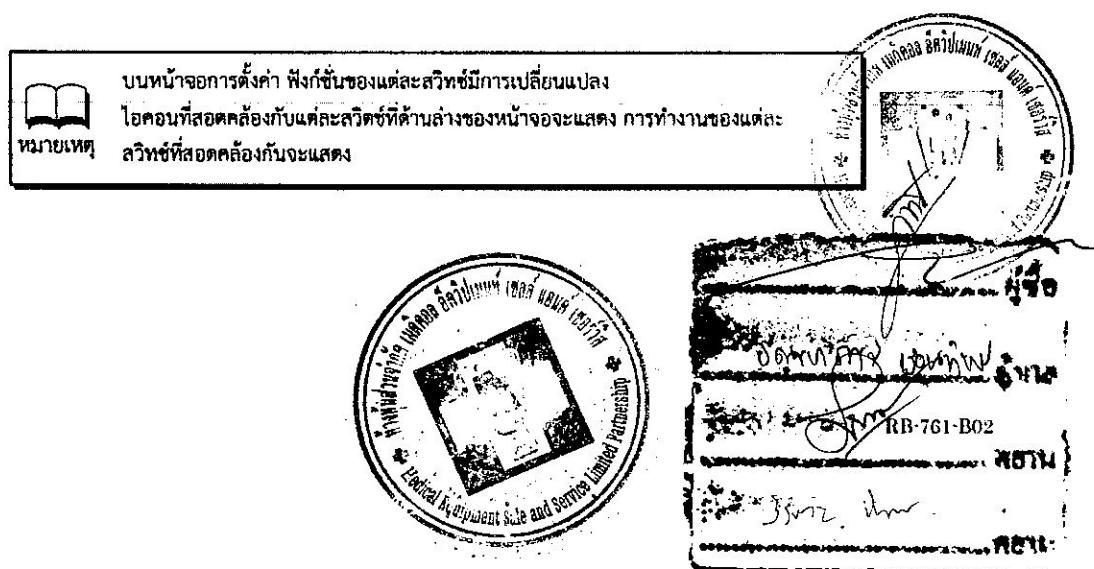

## 8 ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงของกรรไกรความดันอุ่นๆ	1 ถึง 60 [บาร์/Hg] หรือ 0.1 ถึง 8.0 [kPa] ค่ากรรไกรที่ไม่น้อยกว่า 7 mmHg ไม่สามารถกับประทับ
ความละเอียดของกรรไพร	1 [บาร์/Hg] หรือ 0.1 [kPa]
ความถูกต้องของการวัด	$\pm 5$ [บาร์/Hg] หรือ $\pm 0.7$ [kPa]
ระยะห่างการท่างาน	11 [มิลลิเมตร]
ความจุภายใน	เครื่องมือที่ความร้อน (ความกว้างครึ่งเดียว 58 [มิลลิเมตร]) 3.13
ความอนุเคราะห์บิน	5.7 มม. หน้างอนของตีด (ลิ)
ช่วงการซับซ้อนของหน่วยการวัด	หลัก/หน้า $\pm 22$ [มิลลิเมตร] ขาว/เขียว $\pm 43$ [มิลลิเมตร] บน/ล่าง $\pm 17$ [มิลลิเมตร]
ระยะปรับแต่งค่าที่ร่องคาง	$\pm 30$ [มิลลิเมตร]
ขนาด	(กว้าง) 240 [มิลลิเมตร] (ยาว) 422 [มิลลิเมตร] (สูง) 430 [มิลลิเมตร]
น้ำหนัก	ประมาณ 13 [กรัม]
สัญญาณ	อินเตอร์เฟซ RS-232C
ช่วงเวลาทำงาน	100 วินาที 240 [ใบต่อวินาที] 50 / 60 [เซ็ตติ้ง]
หังกับขันปะรุงหัวหัวใจ	3, 5, 10 [นาที] (ตัวอย่าง)




#### 4.3.8 พิมพ์ออกผลการวัด

จะพิมพ์ออกผลการวัดโดยการกดส่วนที่พิมพ์หนังสือจากวัด  
พิมพ์ค่าการวัด 3 ครั้งซึ่งห้าม และค่าการวัดเฉลี่ยล่าหลังตามแต่ละชั้ง  
จะพิมพ์ค่าเฉลี่ยโดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งของการวัด



จะไปพิมพ์ค่าการวัด ถ้าทั้งหมดของค่าการวัดมีความบ้าเบងหรือผิดปกติ

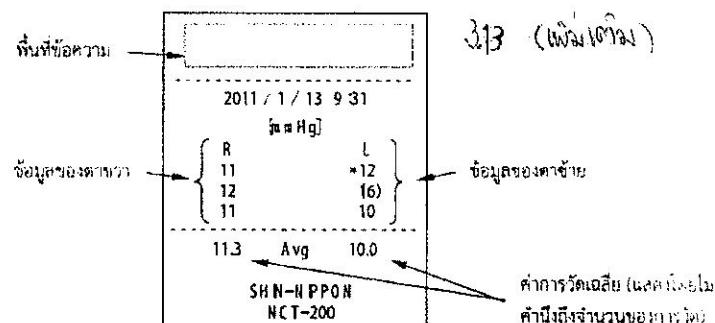

#### \* พื้นที่ข้อความ

สำนักงานพิมพ์อักษรกลางเพียงได้ในช่วงของ 24 วันอักษร / บรรทัด X2 บรรทัดในพื้นที่ข้อความ ถ้าเขียนว่า “ข้อความ” ที่เลือก  
ของ ‘4.4 การตั้งค่าของหน้าจอการตั้งค่า’ เนื่องจากจะเปลี่ยนชื่อเดิมอักษร



กระดาษเครื่องพิมพ์อยู่บ้าน (พิมพ์ชิ้นการป้อน) โดยกลไกวิธี การพิมพ์





# Grandee | บริษัท แกรนดี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

12/1 ถนนราชปรารภพมนา แขวงราชปรารภพมนา เขตสะพานสูง กทม. 10240  
 12/1 Ratpattana Rd., Khwaeng Ratpattana, Khet Sapansung, Bangkok 10240, Thailand.  
 Tel : (662) 540-7677 (Auto) Fax : (662) 540-7678  
 E-mail : info@grandee.co.th Website : www.grandee.co.th

5.3

ที่ บริษัท แกรนดี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งหัวแทนจำหน่ายช่วง

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุด

ด้วยบริษัท แกรนดี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องวัดความดันลูกตาจะบันอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัสนิดใช้ลมเป่า รุ่น NTC-200 ผลิตภัณฑ์ของ RAXXAM ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ขอแต่งตั้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นตัวแทนจำหน่ายช่วง รายการ เครื่องวัดความดันลูกตาจะบันอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัสนิดใช้ลมเป่า รุ่น NTC-200 ผลิตภัณฑ์ของ RAXXAM ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการประกวดราคาซื้อกับโรงพยาบาลชุด จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงสุดวันที่ 30 กันยายน 2566


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แกรนดี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

( นางสาวเจนตี้ เลี่ยงไพรajan )

กรรมการผู้จัดการ





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส  
40/15 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ 053-274997 โทรสาร 053-277102 e-mail : sales.mes43@gmail.com

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

เรื่อง หนังสือรับรอง

เรียน คณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ศิวิชีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ขอรับรองการเสนอ  
ราคา รายการ **เครื่องวัดความดันอุกตกแบบไม่สัมผัสระยะห่าง จำนวน 1 เครื่อง** ตามประกาศจังหวัด  
เชียงใหม่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

- (5.1) 1. ห้างฯ รับรองว่า เป็นผู้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
  - (5.2) 2. ห้างฯ รับรองว่า รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบสินค้า
  - (5.3) 3. ห้างฯ รับรองว่า ผู้นำเข้ามา มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง  
จากบริษัทผู้ผลิตและหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือ  
รับรองการจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่มากอย่าง ณ วันเสนอ  
ราคา
  - (5.4) 4. ห้างฯ รับรองว่า เพื่อความเชื่อมั่นด้านงานคุณภาพ การบริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอ  
ราคาต้องดำเนินกิจการด้านเครื่องมือแพทย์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี
  - (5.5) 5. ห้างฯ รับรองว่า ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเกตตาลีอค  
ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมตราลงลายละเอียดเบริลล์เทียบ  
และทำเครื่องหมายลงหมายเลขให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอรับรองว่าห้างฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ  
ประกวดราคากลุ่ม

(นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา)

ผู้จัดการ




# เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล

และอุปกรณ์วัดส่วนสูงแบบแมนนวล



" BAM " รุ่น BAM-200A

- น้ำหนักตัวสัง 200 kg 3.1
- ค่าละเอียด 50 g (0.05 Kg) 3.2
- ตัวเลข LED สีขาวสูง 35 mm 3.3
- พังค์ชัน : Hold (ล็อกค่าน้ำหนักอัตโนมัติ), Auto Off ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน 20 วินาที
- พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 345 x 380 mm 3.4
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง : 83 - 210 cm ความละเอียด 0.1 cm 3.5
- ระบบเลี้ยงบากน้ำหนักเป็นภาษาไทย 3.6 (เมื่อต้องการเปิด-ปิดเสียง กดปุ่ม VOICE SWITCH)
- พลังงาน : ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V (5V/500mA หรือ 6V/500mA DC Adapter) 3.7
- มาตรฐาน ISO 9001 3.8
- ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
- รับประกันศุภภาพ 1 ปี 3.10

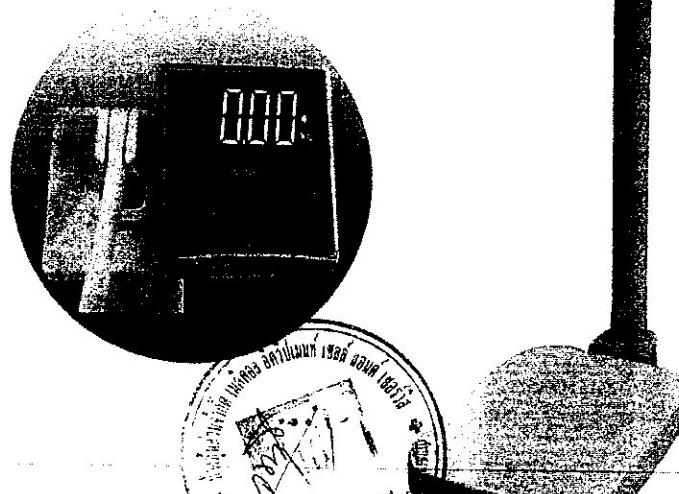

(Updated 18 ก.ค. 2565)

จดจำนำ้ยาโดย

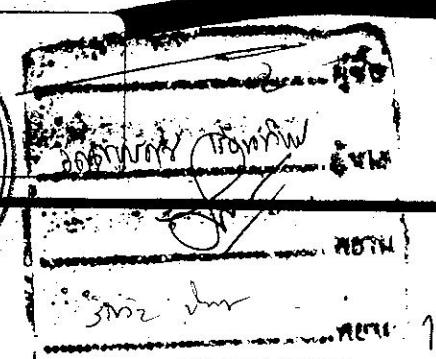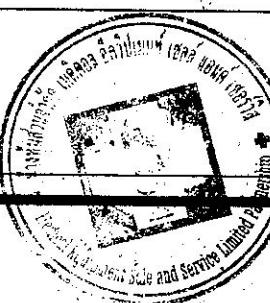

## ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๘๙๗ โดย นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ ๑ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๖๗๗๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ท้องทิงของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาก่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	เครื่องหั่นน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่รัดส่วนสูง	-	๑ เครื่อง	๑๓,๒๐๔.๐๐	๑๒๐
๒	เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่ สัมผัสระยะเขต	-	๑ เครื่อง	๔๘๙,๗๕๐.๐๐	๑๒๐
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๕๐๒,๙๕๔.๐๐</b>	

(สีเสนหกหรือสีฟ้าพื้นเงิน เก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำเสียเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนออนี้ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกใบตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบทั่วไปในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิรูปตัวตนและภาระ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด จำนวนเงินตามที่ระบุในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิรูปตัวตนและภาระ

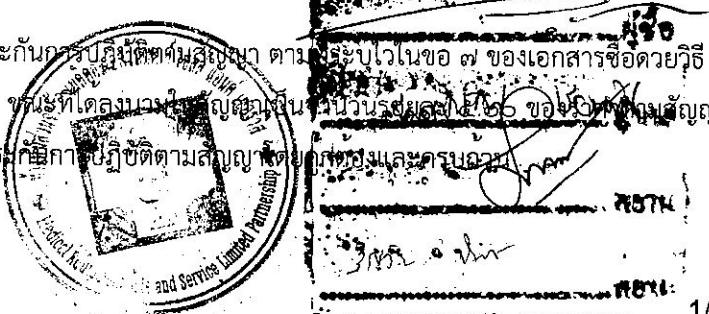

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทกนงสือค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาก่อนแล้วก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออื่น หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอ ข้าพเจ้าขอນอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือทกเหตุผล

๑๐. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และประศาจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๐๐:๐๐ น.

(นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๔๐๗๖๔๑

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๗๑๖๐๐๗๒๐๓

รหัสอ้างอิง OTP XYIW

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๓๔๓๐๐๔๒

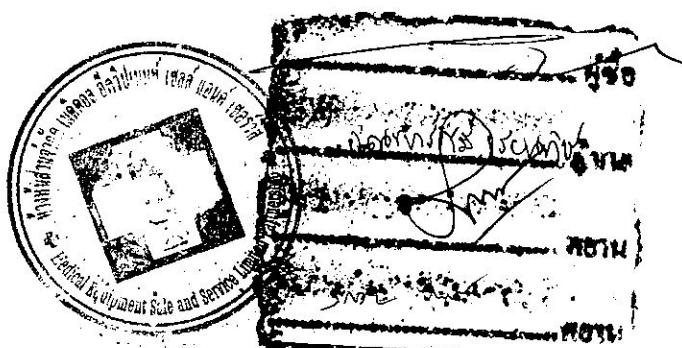



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาชื่อ)

เลขที่ 100063376730

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ สำนักงานดังอัญเชิญที่ 257/23-27 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอ่อนทัย กตัญญกุล และ นางพรวลัย บุญยงค์ ผู้มีอำนาจลงนามยุทธพันธนาการ ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงพยาบาลสหดิษฐ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ชื่อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาชื่อ ขายน 1. เครื่องวัดความดันสูญตาแบบไม่สัมผัสระยะหัวใจจำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องชงน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงจำนวน 1 เครื่อง กับผู้ชื่อ ตามสัญญาเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งผู้ขายต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังผู้ชื่อ เป็นจำนวนเงิน 23,148.00 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมยกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ชื่อ จำนวนไม่เกิน 23,148.00 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการนี้ที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับปรัน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือสูญเสียใดๆ ภัยใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ชื่อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้เนื่องจาก

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน除非ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีดังนี้ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปต่อคราวละเวลาที่ผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลงลายมือชื่อ


(นายอ่อนทัย กตัญญกุล)

พ.ญ. ทิพย์ (4046) ผู้ค้ำประกัน

(นางพรวลัย บุญยงค์)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุวนันต์รุ่งรัตน์ ขัตติวงศ์)

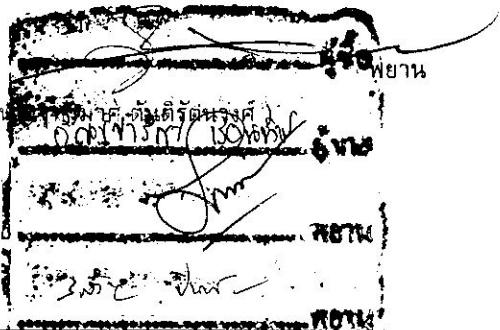

ทางด้านหน้าที่ตั้งที่อยู่ ถนนสุเทพ 257 แขวงสุเทพ เขตใจดี กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 052-230-2300 E-mail: info@kornbank.com


ทางด้านหน้าที่ตั้งที่อยู่ ถนนสุเทพ 257 แขวงสุเทพ เขตใจดี กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 052-230-2300 E-mail: info@kornbank.com

กรณีมีข้อสงสัย สามารถเข้าชมเว็บไซต์ทางการของธนาคารได้ที่ www.kornbank.com หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางการ (By Hand) หรือ (2) ทางโทรศัพท์ 052-230-2300 สำหรับข้อมูลที่ต้องการทราบ ต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฟัง ไม่ตอบ

58-20666136-1-1 -

EFF.C\_2\_NN\_PLUS

2152029



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส  
40/15 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ 053-274997 โทรสาร 053-277102 E-mail : Sales.mes43@gmail.com



### หนังสือมอบอำนาจ

เบียนที่ หจก.เมดิคอล อีควิปเม้นท์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส โดย นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส โดยมอบอำนาจให้ นางสาวอัมชนารัศมี เรือนทิพย์ เป็นผู้กระทำการแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส ในการลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องวัดความดันถูกตัวแบบไม่สัมผัสระจากตา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 449,750.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,205.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 462,955.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลดอย

การได้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ณ วันที่นี้ หมายความ  
หนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา)

(ลงลายมือชื่อ).....


(นางสาวอัมชนารัศมี เรือนทิพย์)



(ลงลายมือชื่อ).....




(นางสาวรีวรรณ ตลาดตะละ)

(ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวกฤตญาณี นาคสุทธิ)

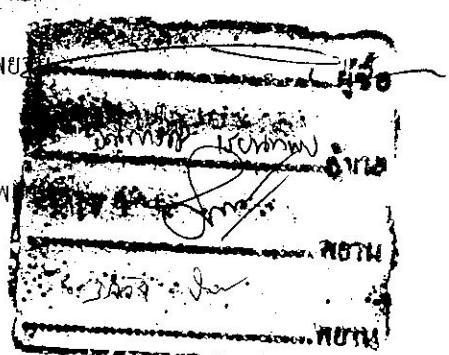

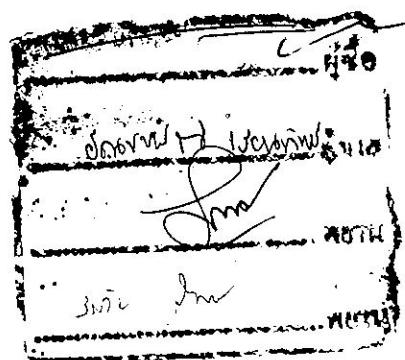

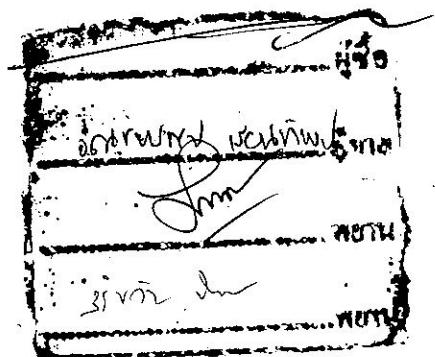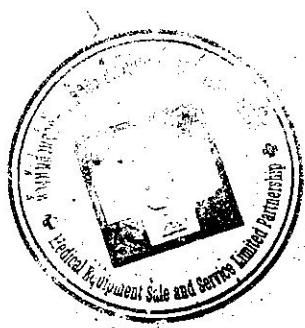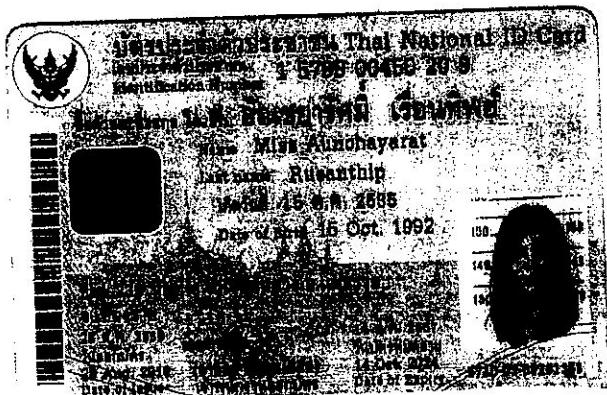



ที่ 100922082606

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0503543004382


ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีโควีปเมนท์ เซลส์ แอนด์ โซลูชัน
  2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 

1. นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา	ลงทุนด้วย เงิน
จำนวน	450,000.00 บาท
2. นางเบญญาภา สุริยะสา	ลงทุนด้วย เงิน
จำนวน	50,000.00 บาท
  3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
    1. นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา/
    2. นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา/
    3. นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา/
    4. นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา/
    5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 40/15 หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/
    6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
- นายทะเบียนชี้รับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวไอย์สุดารักษ์ หอมสมบัติ)

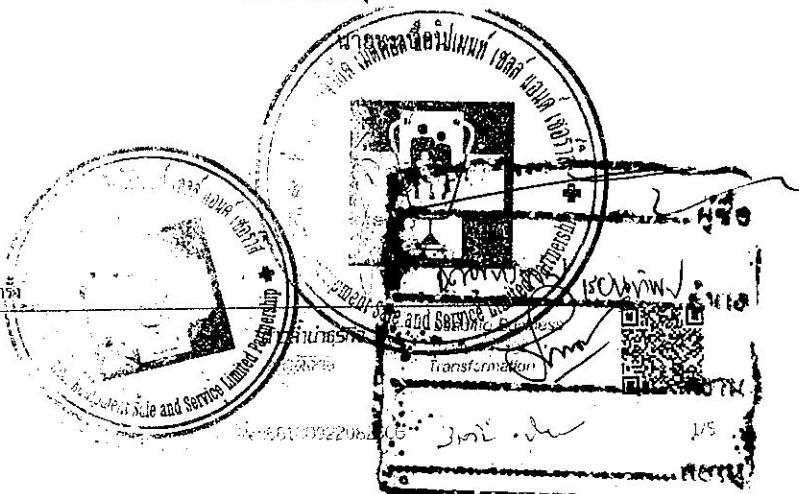

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้กุศรัตน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



ที่ 100922082606

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง


ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922082606

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ยังเท็จจริงเป็นลึกลับหรือไม่
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าเอกสารที่นำมาจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ พิจารณาฐานะ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:59 น.

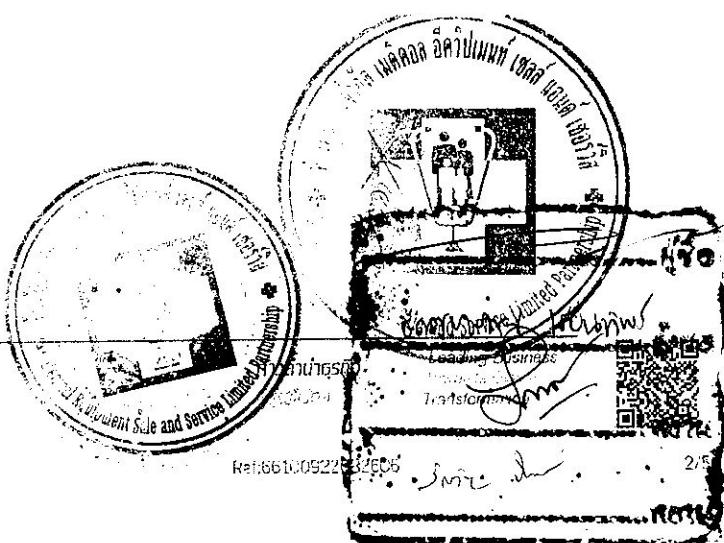

Ref:66100922082606

2/5

ที่ 100922082606

ออกให้ กน. วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีคิวเมเนอร์ เบลส  
แอนด์ เบรเวิร์ส

ก.1 (พ.)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ท้าไว้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า ผู้เชื้อตัว สิ่งของสิ่งของ ครอบครอง ปรับปรุง ซื้อ แรงจัดการ โดยประกาศยื่น ขึ้นที่ทัพย์สินไดๆ ตลอดจน  
ตลอดของทรัพย์สินนี้
- (2) ขาย โอน จำนำ จำหน่าย แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการยื่น
- (3) เป็นนายหน้า ดำเนินค้าต้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในอุตสาหกรรม กิจกรรมที่สหกรณ์ คณะกรรมการค้าหลักทรัพย์  
(4) ภัยเงี่ยน เป็นเงินเดือนบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ภัยเงี่ยนหรือให้เครื่องดื่มด้วยวิธีการยื่น  
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ โอน และลักษณะตัวเงี่ยน หรือรายการที่เปลี่ยนเมื่อได้รับยื่น เว้นแต่ใน  
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครื่องเพลิงเชื้อ
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือเต็งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
- (6) ผู้เป็นหุ้นส่วนจัดความรับผิดชอบในห้องหุ้นส่วนเจ้าตัว เป็นผู้ดูแลหุ้นในบริษัทเจ้าตัว และบริษัทหน่วยงานเจ้าตัว
- วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เม็ดสัตว์ช้างและ เนื้อสัตว์แยก เช่น เม็ดสัตว์บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเข็ม กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
- ปอ ฝ้าย บุ่ง ทิ่่ร์ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว คั้น หมักกระชุด ฯลฯ ฯลў
- (9) ประกอบกิจการค้า ตั้ง ผลไม้ หน่อไม้ หก กิฟฟ่า ที่สวน บุรี ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่มน้ำแข็ง น้ำแข็ง น้ำผลไม้ สรุว เบียร์ อาหาร  
สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลรูหราและป่อง เครื่องครัวป่อง เครื่องปรงสอาหา น้ำซอส น้ำดื่ม น้ำมันพีช  
อาหารสัตว์ และเครื่องบีบีกอสิน
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใบสังเคราะห์ ด้วย ตัวเยางยัด เส้นใบในล่อน ใบสังเคราะห์ เส้นด้ายยิด เครื่องนุ่นห่ม  
เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย หรืองดงาม ตุ๊กตา ถุงยัง เหี้ยวหาง รูปเป้ ภารบ้า เครื่องอุบiquicinii ลีลาห์ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคียงกัน ก เครื่องเรือน เครื่องน้ำใจ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตุ๊กตา เครื่องปั่นน้ำ ฯลฯ
- เครื่องหออกากาส หัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องดูดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น<sup>+</sup>  
เค็บในเคราเพ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอุ่นให้หายล่องและอุปกรณ์ของสินค้าตั้งกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องยืดใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือใช้งานทุกประเภท ศึก เครื่องมือทำสี  
เครื่องตอกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องห่องดง เครื่องห้องเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสูบกัน ก อุปกรณ์ประจำ รวมทั้งอุ่นให้ล่อง  
และอุปกรณ์ของสินค้าตั้งกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องหุ่นยนต์ ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ  
เครื่องบันดูน้ำสี และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยาภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เทคนิคภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปืน<sup>+</sup>  
ยาปฏิชีวนะ ยาบำรุงรักษาและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ล่วงความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ  
และภายนอก เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน  
เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในค้าห้างส่ง
- (18) ประกอบกิจการค้า ห้อง ห้อง กัน ห้อง พอก แลกเปลี่ยน ก ก ห้องน้ำห้องน้ำ ลังตั้งกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



ที่ 100922082606

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีคิวป์เม้นท์ เขล์  
แอนด์ เซอร์วิส


- (19) บริษัทก่อจ้างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือรับเหมาที่มีลักษณะคล้ายกับ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือส่วนรัฐบาล
- (20) ประกอบกิจการค้า ขายหรือซื้อสินค้าด้วยกรรมวิธีทางวิชาชีพ
- (21) สั่งซื้อและจ่ายเงินในประเทศและส่งออกไปจังหวัดต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัสดุที่ใช้
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัสดุที่ประสงค์ให้เก็บบุคคล คณะกรรมการ นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ห้องน้ำในส่วนภูมิภาค



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จดที่ 1450 ว.ม.

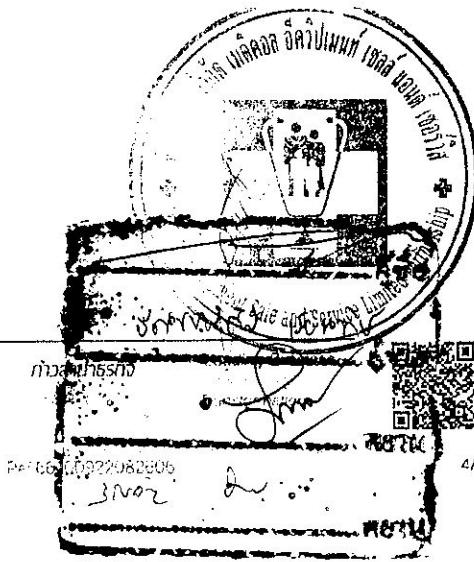


ที่ 100922082606 ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หัวหน้าส่วนราชการ เมตติคอล อีคิวบเมเนอร์ เชลล์  
 แอนด์ เออร์วิส

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ ปี..... 32 ..... ชื่อ คังนี  
 ( 23 ) ทำการซ่อมเครื่องมือแพทย์และข่ายละเอียดเครื่องมือแพทย์  
 ( 24 ) ทำการประกอบธุรกิจเดี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 ( 25 ) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งอะไหล่และอะไหล่ที่ห่วง บริการป่างรักษาและซ่อมแซม  
 ชนบทเป็นค่าปร้าแต่งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทางการแพทย์ทุกชนิด  
 ( 26 ) ประกอบกิจการค้าเครื่องซัก เครื่องอบ เครื่องอบรีด บริการ เครื่องฟอก เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ บริการ  
 ป่างรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  
 ( 27 ) ประกอบกิจการค้าแบบเดือร ถ่านไฟฉาย รวมถึงอุปกรณ์ค้างๆ ที่เกี่ยวกับแนวเดือร ถ่านไฟฉาย ชั้นส่วนอุปกรณ์  
 อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอางไฟฟ้า เครื่องแปรงฟันสีฟ้า เครื่องประดับและเสื้อผ้า  
 ( 28 ) ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์ ชั้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์  
 ( 29 ) ผลิต ประกอบชั้นส่วน และรับซ่อมอุปกรณ์เดี่ยว กับสินค้าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด  
 ( 30 ) ให้บริการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค วิชากรรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอันนั้น  
 ประกอบเป็นอาชีพปกติ  
 ( 31 ) ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์  
 และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโดยช่างประดิษฐ์  
 ( 32 ) ประกอบกิจการจ้างหน่วย ศึกดัง ศิฟท์ พร้อมบริการบำรุงรักษา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

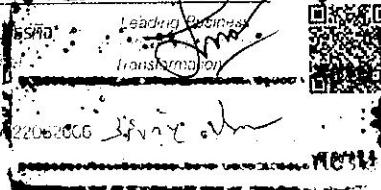



กรมธรรม์ที่ ปม. 7831

แบบ บล. 0101

กรมธรรม์เปลี่ยนการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบเกอร์ล อีกิปเปนต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส


ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543

ออกให้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2543

นายธนวัชร์ย พันธุรักษ์

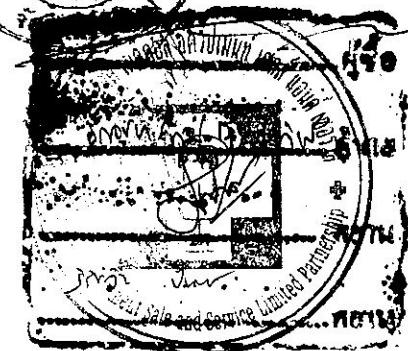

# ภ.ว.20

## ใบทะเบียนภาคชุมชนค่าเพิม

จังหวัดปัตตานี อำเภอหนองสาคร ตำบลหนองสาคร บ้านหนองสาคร หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ธานี

ชื่อสถานประกอบการ

เต็ง บุญ

สำเนาจดหมาย

สาขาที่

หนองสาคร

หนองสาคร

ห้องเช่าที่

หนองสาคร

หนองสาคร

เลขที่ 40/15

ชื่อเจ้าของบ้าน

ตัวอักษร/ชื่อย่อ

ชื่อบุคคล

อ้างอิง/เขต

เมืองสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เช่าบ้าน

เอกสารให้เช่าบ้านที่

รหัสไปรษณีย์ 50200

โทรศัพท์

ชื่อผู้เช่าบ้าน

เอกสารให้เช่าบ้านที่

2544

บ้าน

ชื่อผู้เช่าบ้าน

เอกสารให้เช่าบ้านที่

บ้าน

ชื่อผู้เช่าบ้าน

เอกสารให้เช่าบ้านที่

บ้าน

ชื่อผู้เช่าบ้าน

เอกสารให้เช่าบ้านที่

บ้าน

ชื่อผู้เช่าบ้าน

เอกสารให้เช่าบ้านที่

บ้าน

ก.ก.ด.ท.

08500010-25510622-1-99-0000360 08509-08500010-08500010-1-99-25560622-0-0-0004-59 08500000

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งของชำร่วย พืชผลและสัตว์น้ำที่ไม่ได้เป็นยาสูบและยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศ.๓๖๘

หน้าที่ออกใบอนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นายสุจารุ ว่องยิ่น)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศักดิ์ ไกรเดช)

ผู้รับใบอนุญาต

(นายสุจารุ ว่องยิ่น)

ผู้รับใบอนุญาต

(นายศักดิ์ ไกรเดช)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 5 0 3 9 - 4 3 0 0 4 - 3 8 - 2

ລະກົດ e-GP 05-C102

ວັນທີແຈ້ງຄວາມເປັນ 04/11/2553

## ແບບນັດສອກການຄອກຫາເປັນໃນຮບບ e-GP

ວັນທີອຸນຸມຕິ 12/11/2553

ສູນເຜົ່າພະນັກງານ ພ. 2553-4-04866

ວັນທີເຮັດໄຟ່ຈາກ 15/11/2553

## ສໍາຮັບຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະກຳດູກການກັບກາທີ້ງ

1.ເພື່ອປະເປົ້າ ເຊື້ອຸ້ນໆຢ່າກເຊົາກອບ 354354354354354354

ບະຊາດຫຼັງປະກອບການ ໂດຍບຸກຄອດ

2.ສື່ສາການປະກອນການ ນ້າມຫຼຸບສ່ວນລົ້ມ ໝໍາລືກສ ສີລິມິປົກາ ເລກທີ່ 04866 ແຂວະເຊີ້ວສ

3.ອ້ອກາຫຼັກດູກ (ລໍາຕີ) Medical Equipment Sale and Service Ltd., Part.

3.ທີ່ສື່ສັນກັກການ ອາການ

ຫັນທີ

ໜຶ່ງປັນ

ເລກທີ່ 40/15

ຫຼັງທີ່ 10 ທົດກົມ/ຮບບ

ດັນ ສູນກາ

ຕະນະ/ເຊົາ ສູນກາ

ອຳນາຍ/ເຊົາ ມືອງເປົ້າໂຈນ

ຈັງຫວັດ ເມືອງໃຫມ່

ຮັດສປຣມເສີມ 50200

ໂທເລັກທີ່ 0946204975

ອັນເມືອນ mess2543@hotmail.com

## 4.ກຣນິບຸກຄອນຮຽມດາ

(ເລີ່ມປະຈຳຕໍ່ປະຫາຍນ - )

ວັນ/ເດືອນ/ປີເກີດ

ສັນຕະລິ ຖະໄຍ

## 5.ປະເທດການປະກອບການ

ປະເທດການ

ປະເທດເລີນດັບແລະຫຼົບບົກຄະ

5.ກຣນິບຸກຄອນບຸກຄອດ

ທະບຽນນິຕິບຸກຄອດເລກທີ່ 0500543004382

ວັນເດືອນປີເກີດທະບຽນ 12/12/2543

ຈົດທະບຽນທີ່

ຖຸນ

(1) ເຕັມຖຸນອດທະບຽນ

500000.00 (ບາດ)



(2) ຖຸນ.ອດທະບຽນທີ່ຂໍາຮັບແດນ

500000.00 (ບາດ)

 ກຣນິບຸກທະບຽນລົງທຶນຂອງມູນຄົມຫຼວງປະກາທີ່ມີເຫດຜາສີໃນຮບບການຈັດອື່ອດັບຈຳລັດກາກົງລົງ ຈະດູກໃຫຍ່ໄດ້ ກຣນິບຸກທະບຽນການທຳກາໄຕດ້າວັນເປັນກາລວງຄອນເມື່ອສີໃນກວ່າຍ໌ເສີນທາງນຸ່ງດູກ ສູ່ລົງທະບຽນຈະຕ້ອງຮັບກີດຂອນເຕີ່ເຫັນງຸ່ງດູກ

ພາຍເທຸ : ແບບນັດສອກສາຍະເລັດໃນຮບບ e-GP ລາມຮາດກຳໄປບັນຫຼວມເຄີດກາເສຍອະດົກ ຕັ້ງໜ່ວຍງານກາກົງລົງ ດັ່ງແລ້ວນີ້ 1 ພຶສພານ 2555 ເປັນຕົ້ນໄປ ສານວິການຈົດໜ້ອງ  
 ລັດທັງທີ່ມີງານດັ່ງນີ້ 2,000,000 ນາທີ (ສອນຈຳນາທີ) ຫຼືວ່າ ທີ່ນີ້ຕີ້ໄດ້ປັນໃນປາກປະເທດ ເລັດແນກງານການປ້ອງກັນແລະນ່ວຍປາກປະກາງຫຼົງແລ້ວຫາສີ  
 ເຊື່ອກະທິບາດຕົ້ນແລະວິກາຫຼອດກຳມັນ ແລະແຫຼັກຫຼັກ ຮູ່ທຸກທີ່ໄດ້ຮັບກັນຫຼັງການກ່ຽວຂ້ອງມືດີບຸກຄົມບົກຄົມຫຼູດກັນຫຼາຍຂອງຮັກ ໩. 2554 ແລະແກ້ວ  
 ເກີນເລີຍທີ່ກຳຫຼັກຕໍ່ເຫຼື່ອກ່ຽວຂ້ອງເຈັນປົນກຸງກົດໜູນກັບໜົນການກາກົງລົງໃຫ້ຈຸດໜູນມີຄວາມຄາມເຈັນນັ້ນດີກຳຈຳລົດການນີ້ໃນຮບບ e-GP

ຄົນກຳເຊື່ອວັນທີ 06/08/2563 ເວລາ 14:48 ດົ. ວິຊີ yRI4CU

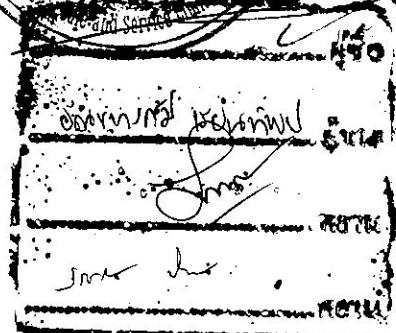


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
**นาย จักรกฤษณ์ สุริยะสา**  
**ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส**

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0503543004382
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
 พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
 ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ<sup>๑</sup>  
 สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30  
 มิถุนายน 2567

นายชาวนย์ สถาศต์-โชติ  
 รองผู้อำนวยการ  
 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 นายทะเบียน

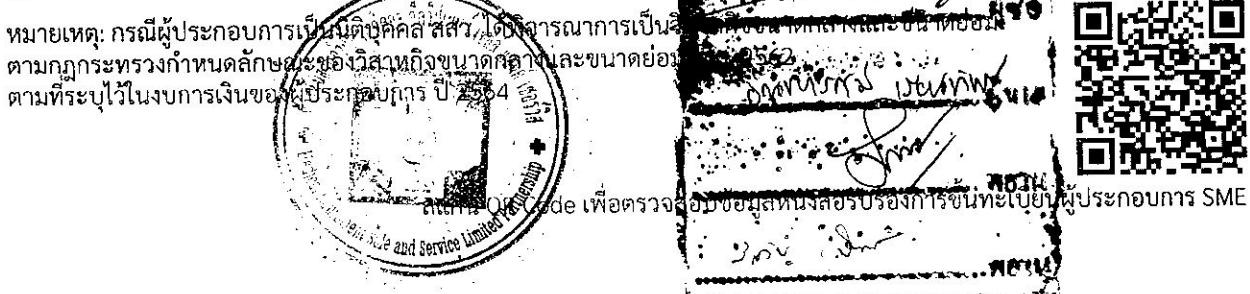

บัญชี ห้องน้ำหนาดและเงื่อนไข Terms and Conditions  
สมุด บัญชี ห้องน้ำหนาดบัญชี สาขา ลิซซ์ท 79600€

1. โปรดนำบัญชี นามบัตรประจำตัวเจ้าของบัญชี หรือบัตรประชาชน

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย ข้าราชการไม่สามารถห้องโถงลับ กรณีสูญหายจะต้องได้รับค่าเสียหาย หรือต้องเสีย 02 111 111 และนำไปยังธนาคารเดิมที่ออกบัญชี เพื่อขอของเสียคืนจากไปรษณีย์ไทย กรณีสูญหายต้องนำบัญชีไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรับบัญชีใหม่

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. ผู้คนเดียวเท่านั้น สามารถเบิกถอนเงินสดได้

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในบัญชีห้องน้ำหนาดจะถูกตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำบัญชีมาใช้รายการอ้างอิง เดือนละครั้ง ให้ถูกต้องกับบัญชีที่บันทึกไว้ในบัญชี หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. การเบิกจ่ายเงินเดือนที่ต้องคำนวณผลบัญชีเดือนแรกตามเดือนที่ใช้เดือนที่ก่อนเดือนที่ต้องการเบิกจ่าย เนื่องจากเดือนแรกไม่สามารถเบิกจ่ายได้

Interest in saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่มีจำนวนเงินต่ำกว่าบัญชีที่กำหนด ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 0.5% และ/หรือ ติดต่อกรมธรรม์เพียง แต่คราวเดียวที่ต้องชำระหากหมด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. จำนวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และ/หรือ ติดต่อกรมธรรม์เพียง แต่คราวเดียวที่ต้องชำระหากหมด

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for  
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1521  
Office

บัญชีเลขที่ 521-1-84269-3  
Account No.

สาขาถนนสุภาพ

ชื่อบัญชี  
Account Name

นาง. เมศิค อุ๊ค วิปเมนท์ ชาลล์ แอนด์  
เชอร์วิส



SA AA 8422777

ลายเซ็นผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

